

目 錄

安全性	3
安全符號	3
安全和使用注意事項	3
靜電	3
1. 概述	4
1.1 記錄器的特性	4
1.2 輸入卡和輸出卡	4
1.3 通訊	5
1.4 儲存媒體 (CF 卡)	5
1.5 資料安全性	5
1.6 紅外線感測器 (IR)	6
1.7 產品訂購序號及配件	6
1.8 詳細規格	9
2. 裝機和配線	13
2.1 開箱	13
2.2 裝機	13
2.3 輸入和輸出設定與說明	16
2.3.1 類比輸入卡(產品序號 AI 181、AI 182、AI 183)	16
2.3.2 數位輸出卡(DO181)/6 點警報輸出	17
2.3.3 數位輸入卡(DI181)	17
2.3.4 類比輸出卡(AO183I, AO183V)	17
2.3.5 24VDC 輔助電源卡 (AP181)	17
2.4 輸入 / 輸出卡接線說明	18
2.5 RS232/422/485 接線說明	21
2.6 安裝 CF 卡	22
3. 基本操作	23
3.1 頁面 (Page)	23
3.2 模式 (Mode)	24
3.3 歷史資料 (History)	24
3.4 事件 (Event)	25
3.5 狀態 (Status)	27
3.6 離開 (Exit)	27
3.7 儲存 (Dump)	27

3.8	清除 (Clear)	27
3.9	操作 (Operate)	28
3.10	關機 (Shutdown)	28
3.11	小圖形說明	28
4.	組態設定	30
4.1	通道 (類比輸入、數位輸入、類比輸出、數學輸入)	31
4.2	畫面	38
4.3	工具 (標準：計時器，選配：計數器及累加器)	40
4.4	裝置	44
4.5	日期時間	46
4.6	安全密碼與符合 FDA21 CFR part11 規範之功能 (選配)	47
4.7	展示	48
4.8	系統資訊	48
4.9	組態設定範例	50
5.	電腦應用軟體－觀察者一號&二號	52
5.1	觀察者一號 (標準) & 二號 (選配) 軟體說明	52
5.2	Ethernet 組態設定	55
5.3	RS232, RS485, RS422 組態設定	59
5.4	使用 CF 卡組態設定	62
5.5	在 Real-Time Viewer 下設定組態	64
5.6	DDE 動態資料交換	67
6.	應用範例	73
7.	答客問-常見問題說明	75

安全性

VR18 記錄器符合 EN61010-1、UL61010C-1 以及 CSA C22.2 No. 24~93 等規範，請按照此操作手冊說明正確使用記錄器，對於未依本操作手冊之正確使用方法或超出記錄器規格中所敘述之應用方式或環境條件限制，而對於產品的可靠度所造成之影響與損壞，本公司不負賠償的責任。

安全符號

以下為記錄器或操作手冊上標示之安全符號所代表的意義：



警告



接地線



直流電源

安全和使用注意事項

1. 進行配線前請先將接妥接地線。為避免在過失的狀況下對記錄器造成危害，請勿中斷或移除接地線的保護（包含外部的接地線導線及記錄器內的接地線路），即使是手提式機種，在使用高壓電源時，亦須接妥接地線。
2. 訊號線與電源線應作分隔配線，但若現場施作上無法作分隔配線時，訊號導線應使用具絕緣/抗干擾的披覆的線材。若使用高壓電源時，則訊號導線應使用雙層絕緣/抗干擾披覆的線材。
3. 請勿在高度震動或電磁干擾強烈的場域使用，以免造成記錄器損害、ERROR 或量測誤差。
4. 在進行任何的維修或保養前，請先將電源線移除，以預防因意外觸碰電源而導致人員受傷或記錄器損壞。
5. 安裝於有傳導性物質（如金屬塵屑、水等等）的污染環境中，應作適當的通風過濾或密封措施。
6. 清潔記錄器請小心進行並使用乾燥、柔軟的布料。避免使用砂紙、硬物或尖銳的工具以免損壞螢幕。
7. 在記錄器任何元件、模組遭移除或拆解的情況下請勿進行操作，並儘快聯絡經銷商協助處理。

靜電

使用記錄器時請採取適當的靜電防護措施。記錄器的電路板和元件會受靜電釋放的影响造成損壞。操作時，請採取適當的防護措施。在使用記錄器與插拔 CF 卡時，請採取適當的靜電防護措施。

更換電源保險絲

記錄器的電源保險絲安置於電源板上的保險絲固定夾上。使用 90~250VAC 電源時，需使用 2.5A / 250VAC (Time-lag 慢熔) 保險絲，11~18VDC 及 18~36VDC 需使用 5.0A / 250VAC (Time-lag 慢熔) 保險絲。

1. 概述

1.1 記錄器的特性

VR18 是一台經過巧思設計具有多項傑出功能的記錄器，它的特點包括：

- 6.4 吋寬 TFT 彩色 LCD 顯示螢幕，640 x 480 的高解析度點陣。
- 最多可達 18 點隔離的類比輸入通道。
- 可擴充式插槽，擴充容易。
- 簡易、友善的操作方式。
- 紅外線螢幕保護裝置可延長螢幕的壽命。
- 固態儲存媒體 CF 卡提供高容量的儲存解決方案。
- 174mm 的深度，空間需求小。
- 標準 Ethernet 通訊介面，也可選配 RS232 /422/485 通訊介面。
- 高解析精度的 18-bit A-D 類比輸入。
- 15-bit D-A 類比輸出。
- 200 毫秒的採樣速率。
- 有盤面型與附把手的可攜式桌上型可供選擇。

1.2 輸入卡和輸出卡

記錄器後端有 6 個擴充槽，可依客戶需求彈性安裝下列 I/O 卡：

類比輸入卡(AI181, AI182, AI183, AI183)：我們提供單點通道、兩點通道及三點通道三種類比輸入卡。通道與通道間的電路採隔離設計以避免雜訊干擾並確保量測的穩定性。在將類比輸入卡插入擴充槽前，請先參考輸入卡上的貼紙圖示，依輸入訊號的種類調整 DIP 開關和跳線 (JUMP) 裝置 (細節請參考 2.3 設定輸入和輸出卡)。

數位輸出卡(DO181)：具備 6 個繼電器接點 (5 A/240VAC)，作為警報輸出用。

數位輸入卡(DI181)：具備 6 個通道，提供 Logic Low: 最小 -5V，最大 0.8V 與 Logic High: 最小 2V，最大 5V。

類比輸出卡(AO183I, AO183V)：具備 3 個類比輸出通道。AO183I 為 4~20mA、0~20mA 的線性（電流）訊號輸出型式，AO183V 為 0~5V、1~5BV、0~10V 的線性（電壓）訊號輸出型式。

1.3 通訊

標準通訊介面為通訊協定 IEEE 802.3 10 Base T 的乙太網路（Ethernet），另可選配 RS-232 / RS-422 / RS-485 三合一通訊介面。

1.4 儲存媒體（CF 卡）

記錄器除內建 8MB 記憶體外，並隨貨附 32MB 的 CF 卡（標準配備），CF 卡儲存容量高、體積小，攜帶方便且防塵 / 防震的能力佳，提高了存取資料的信賴度。

欲讀取 CF 卡上資料，可以用 CF 讀卡機連接電腦的 USB 連接埠來讀取。CF 卡的容量可依實際需要，選用 256MB、1GB...等較大容量之 CF 卡，若需購買可以聯絡經銷商或自行購買（由於廠牌眾多為確保 CF 卡相容性，建議您選用 San Disk 品牌）。

欲下載記錄器資料到 CF 卡時，需先將 CF 卡插入記錄器的 CF 插槽，並按“下載”按鍵，將記錄器上的組態與量測資料載入 CF 卡。

以下列出 CF 卡可用天數的簡表（以標準 6 通道估計）

CF 卡容量 記錄速度	32 MB	256 MB	1 GB
1 秒	30 天	240 天	960 天
10 秒	300 天	2400 天	9600 天
120 秒	3600 天	28800 天	115200 天

記錄一筆量測資料須使用 CF 卡 2 bytes 的記憶容量，舉例來說，當您記錄一個通道，每秒鐘記錄一點時，32MB CF 卡可讓您持續 24 小時記錄達 184 天左右。

[=32 MB / (2bytesx24 小時x60 分鐘x 60 秒)](不記錄事件的狀態下，每筆事件佔 32bytes)

可記錄天數之計算公式：（在不記錄事件的狀態下，每筆事件佔 32bytes）

可記錄天數 = CF 卡容量 / (2 bytes / 取值速度 (1S, 2S, 5S, 10S.....) x 每天工作時數 x 3600 秒)

為避免記錄器上的資料遺漏，在您把 CF 卡從記錄器取出，在電腦上作完資料備份後，請儘快將 CF 卡插回記錄器。

1.5 資料安全性

記錄器的資料是以製造商的特別格式儲存，原始記錄資料無從篡改，這項特性提高了資料的安全性。

1.6 紅外線感測器 (IR)

使用紅外線偵測是創新的做法用以延長 LCD 螢幕的使用壽命。紅外線可以在 2 公尺左右的距離偵測人員移動，紅外線偵測功能須與螢幕保護程式共同使用。欲開啟紅外線偵測的功能，您需先進入記錄器的“裝置”中設定銀幕保護功能，例如：將紅外線感測器設定在“開&關：IR”，銀幕保護設定為“10 分鐘”（出廠預設值），當記錄器前方無人員移動達十分鐘之久時，螢幕會自動進入休眠狀態，一旦有人靠近記錄器，螢幕便會自動開啟，毋需按記錄器上任何鍵。

1.7 產品訂購序號及配件

產品訂購序號

VR18 - □ □ □ □ - □ □ □ - □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1、電源

- 4：90-250VAC, 47-63 Hz
- 5：20-28VAC, 47-63 Hz
- 6：11-18 VDC
- 7：18-36 VDC
- 9：特別規格

2、類比輸入卡

- 0：無
- 1：1 點類比輸入 (AI181)
- 2：2 點類比輸入 (AI182)
- 3：3 點類比輸入 (AI183)
- 4：4 點類比輸入 (AI181 & AI183)
- 5：5 點類比輸入 (AI182 & AI183)
- 6：6 點類比輸入 (AI183)
- A：9 點類比輸入 (AI183)
- B：12 點類比輸入 (AI183)
- C：15 點類比輸入 (AI183)
- D：18 點類比輸入 (AI183)
- G：3 點電壓輸入 (AI183V)
- H：6 點電壓輸入 (AI183V)
- J：9 點電壓輸入 (AI183V)
- K：12 點電壓輸入 (AI183V)
- L：15 點電壓輸入 (AI183V)
- M：18 點電壓輸入 (AI183V)

* AI181/2/3(V)請參考 P.8 配件說明。

3、數位輸入卡

- 0：無
- 1：6 點
- 2：12 點
- 3：18 點
- 4：24 點
- 5：30 點
- 6：36 點

4、數位輸出卡

- 0：無
- 1：6 點 3：18 點
- 2：12 點 4：24 點

5、通訊

- 0：標準乙太網路介面
- 1：RS-232/422/485 (三合一)+ 乙太網路介面
- 9：特別規格

6、電腦軟體

- 1：標準版軟體觀察者一號 (Observer I)，無即時監看功能。
- 2：加強版軟體觀察者二號 (Observer II)，支援 RS232/422/485 和乙太介面的即時監看功能。

7、韌體

- 0：基本功能
- 1：數學運算、計數、累加功能與 FDA21 CFR II 規範版

8、儲存媒體

- 1：128MB CF 卡 (Compact Flash Card)
- 4：256MB CF 卡
- 5：1GB CF 卡
- X：其他

9、外殼

- 1：標準盤面式，灰色外殼
- 2：桌上/手提兩用型，附美規電源線，灰色外殼
- 3：桌上/手提兩用型，附歐規電源線，灰色外殼
- 4：標準盤面式，黑色外殼
- 5：桌上/手提兩用型，附美規電源線，黑色外殼
- 6：桌上/手提兩用型，附歐規電源線，黑色外殼

10、特別選項

- 0：無
- 1：24VDC 輔助電源 (供傳送器用, 6 點)
- 2：3 點電流 (AO183I) 輸出
- 3：6 點電流 (AO183I) 輸出

- 4：9 點電流 (AO183I) 輸出
- D：3 點電壓 (AO183V) 輸出
- E：6 點電壓 (AO183V) 輸出
- F：9 點電壓 (AO183V) 輸出
- 5：盤面式附電源插頭
- 6：盤面式附 (前面) 電源開關
- 7：24VDC 輔助電源 + 電源插頭 (1+5)
- 8：24VDC 輔助電源 + (前面) 電源開關 (1+6)
- 9：24VDC 輔助電源 + 電源插頭 + (前面) 電源開關 (1+5+6)
- X：其他規格

注意事項：

- ◆ 記錄器本身有 6 個擴充槽，因此最多共可插入 6 張卡 (輸入、輸出或 24VDC 輔助電源卡)，例如：若是 12 個通道的記錄器，須插入 4 個 3 通道的類比輸入卡，因此，只剩下 2 個擴充槽供其他種類的輸入/輸出卡使用。
- ◆ 標準版電腦軟體—隨機附觀察者一號軟體 (免費)。
加強版電腦軟體 (選配) —觀察者二號軟體可支援三合一通訊介面 RS-232/422/485 (另購) 或乙太網路。

配件

產品序號	說明
AI181, AI182, AI183	1 / 2 / 3 點類比輸入卡(TC, RTD, +mA, +V, +mV)
AI183V	3 點電壓輸入卡(±mA, ±V, ±mV)
DI181	6 點數位輸入卡
DO181	6 點繼電器接點輸出卡 (AC/DC)
AP181	24VDC 輔助電源，供 6 組傳送器用
CM181	RS-232/422/485 + 乙太通訊模組
CM182	標準乙太通訊模組
PM181	90-250VAC, 47~63Hz 電源板
PM182	11-18VDC 電源板
PM183	18-36VDC 電源板
PM184	90-250VAC, 47~63Hz 電源板附電源插頭
PM185	36-72VDC 電源板
PM186	20-28VAC 電源板
MK181	盤面式套件 (灰色)
MK181B	盤面式套件 (黑色)
MK183	桌上型/手提式套件 (灰色) /美規電源線
MK183B	桌上型/手提式套件 (黑色) /美規電源線
MK184	桌上型/手提式套件 (灰色) /歐規電源線

MK184B	桌上型/手提式套件 (黑色) /歐規電源線
CF032	32MB CF 卡
CF256	256MB CF 卡
CF1000	1GB CF 卡
AS181	標準版電腦軟體 - 觀察者一號
AS182	加強版電腦軟體 - 觀察者二號
AO183I	3 點電流輸出卡 (0~20mA / 4~20mA)
AO183V	3 點電壓輸出卡 (0~5V / 1~5V / 0~10V)
BT181	Boot ROM 無數學、計數、累計功能
BT182	Boot ROM 含數學、計數、累計功能與符合 FDA21 CFR11 規範
SC181	空槽蓋
SNA10A	RS-485 轉 RS232 轉換器
UMVR181	操作手冊

1.8 詳細規格

電 源：90-250VAC，47-63Hz，60VA，30W maximum
11-18VDC or 18-36 VDC 60VA，30W maximum

顯 示：6.4" TFT LCD，解析度 640×480 pixel，256 色

記憶體：內建 8MB 記憶體

儲存媒體：32MB (標準配備)，256MB (選配)，1GB (選配)

類比輸入卡 (AI181,AI182,AI183)：

AI181：1 點，AI182：2 點，AI183：3 點

解析精度：18 bits

取樣速率：5 次/秒

最大額定值：最小：-2VDC，最大 12VDC (1 minute for mA input)

溫度效應：mA 輸入： $\pm 3.0\mu V / ^\circ C$

其它輸入： $\pm 1.5\mu V / ^\circ C$

感知器導線阻抗效應：T/C： $0.2\mu V / ohm$

3 線 RTD： $2.6^\circ C / 兩根導線阻抗歐姆值的差$

2 線 RTD： $2.6^\circ C / 兩根導線阻抗歐姆值的和$

易燃電流：200nA

共模抑制比 (CMRR)：120dB

常模抑制比 (NMRR)：55dB

隔離失效電壓 (兩通道間)：最小 430VAC

感知器斷線偵測：TC、RTD、mV 輸入訊號：斷線 (呈開路狀態) 時

4-20mA 輸入訊號：小於 1mA 時

1-5V 輸入訊號：小於 0.25V 時

其它輸入不適用

感知器斷裂反應時間：TC，RTD，mV 輸入：10 秒內；4-20mA 輸入：0.1 秒

AI181/AI182/AI183 特性：

訊號型式	範圍	在 25°C 的精準度	輸入阻抗
J	-120~1000°C	±1°C	2.2MΩ
K	-200~1370°C	±1°C	2.2MΩ
T	-250~400°C	±1°C	2.2MΩ
E	-100~900°C	±1°C	2.2MΩ
B	0~1820°C	±2°C (200~1820°C)	2.2MΩ
R	0~1768°C	±2°C	2.2MΩ
S	0~1768°C	±2°C	2.2MΩ
N	-250~1300°C	±1°C	2.2MΩ
L	-200~900°C	±1°C	2.2MΩ
PT100 (DIN)	-210~700°C	±0.4°C	1.3KΩ
PT100 (JIS)	-200~600°C	±0.4°C	1.3KΩ
mV	-8~70mV	±0.05%	2.2MΩ
mA	-3~27mA	±0.05%	70.5Ω
0~1V	-0.12~1.15V	±0.05%	332KΩ
0~5V	-1.3~11.5V	±0.05%	332KΩ
1~5V	-1.3~11.5V	±0.05%	332KΩ
0~10V	-1.3~11.5V	±0.05%	332KΩ

電壓輸入卡 (AI181V,AI182V,AI183V)：

AI183V 特性

訊號型式	範圍	在 25°C 的精準度	輸入阻抗
-60~60mV	-62~62mV	±0.1%	2.2MΩ
-20~20mA	-22~22mA	±0.1%	70.5Ω
-2~2V	-2.2~2.2V	±0.3%	332KΩ
-20~20V	-22~22V	±0.1%	332KΩ

數位輸入卡 (DI181)

通道數：每張輸入卡 6 個

低邏輯電壓：最小 -5V，最大 0.8V

高邏輯電壓：最小 2V，最大 5V

外在失效阻抗：最大 1KΩ

外在生效阻抗：最小 1.5 MΩ

數位輸出卡 (DO181)

通道數：每張輸出卡 6 個

接觸型式：N.O. (form A)接點

繼電器額定值：5A / 240VAC，使用壽命 20 萬次（電阻負載）

電壓輸出卡 (AO183I,AO183V) :

通道數：每卡 3 組輸出點
輸出訊號：AO183I：4~20mA，0~20mA；AO183V：0~5V，1~5V，0~10V
解析精度：15 bits
精 度：±0.05% 的範圍值±0.0025% /°C
負載阻抗：0~500 歐姆（電流），10K 歐姆（電壓）
輸出調整：滿載時的 0.01%
輸出設定時間：0.1 秒（穩定度 99.9%）
隔離失效電壓：1000VAC min.
線性誤差：±0.005% 範圍值
溫度效應：±0.0025% 範圍值 / °C

24VDC 輔助電源卡 (AP181) :

通道數：每張電源卡 6 組 24VDC 電源輸出，供傳送器使用
輸出額定值：24±1 VDC，最大 180mA，30mA/通道

RS-232/422/485 三合一通訊模組 (CM181) :

介面：RS-232 (1 台)，RS-485 或 RS-422 (最多可串接 247 台)
通訊協定：Modbus RTU 格式
位址：1 - 247
通訊速率：0.3 ~ 115.2Kbits / sec.
資料位元：7 或 8 bits
檢查位元：None，Even 或 Odd
停止位元：1 或 2 bits

標準 Ethernet 通訊：

通訊協定：Modbus TCP / IP，10 Base T
通訊埠：AUI (Attachment Unit Interface) 和 RJ-45，可自動偵測

紅外線偵測器：

感測距離：2 公尺左右（人或物體的移動）
延遲時間：可設定為 10, 20, 30, 40, 50 或 60 分鐘

即時連線時間精度與記錄器(機殼內)溫度關係：

機殼內溫度	時間誤差(每月)
10°C~40°C	18 秒
0°C 或 50°C	52 秒
-10°C 或 60°C	107 秒

工作環境和物理條件：

工作溫度：5 ~ 50°C

儲藏溫度：-25 ~ 60°C

濕度：20 ~ 80% RH(非凝結狀態)，最大相對溼度 80% (達 31°C 時)，相對溼度會
隨溫度增加呈線性遞減，40°C 時，最大相對濕度為 50%

工作高度：海拔 2000 公尺

絕緣阻抗：最少 20M 歐姆 (500VDC 時)

耐壓性：1350VAC，50/60Hz，1 分鐘

耐震性：10-55Hz，10m/s² 兩小時

耐衝擊性：工作時 30m/s² (3g)，運送時 100g

架設傾斜度：沒有傾斜角度限制

產品尺寸：盤面型 - 166 (W) x 144 (H) x 174mm (D)

桌上型 - 166 (W) x 192 (H) x 194mm (D)

盤面開孔尺寸：138 x 138mm DIN 尺寸

通過安規檢驗標準

安規：UL61010C-1，CSA C22.2 No.24-93

CE：EN 61010-1 (IEC1010-1) Over Voltage Category II，Pollution degree 2

防護等級：前面板：IP30，室內使用

外殼和後座端子：IP20

電磁干擾：

發射性：EN61326(EN55022 class A，EN61000-3-2，EN61000-3-3)

抗擾性：EN61326(EN61000-4-2，EN61000-4-3，EN61000-4-4，EN61000-4-5，
EN61000-4-6，EN61000-4-8，EN61000-4-11)

2. 裝機和配線

2.1 開箱

- 若開箱時發現產品有缺損，請立即和您的經銷商聯絡。
- 建議您保存包裝材料，以備未來運送包裝需要。

2.2 裝機

⚠ 清除 VR18 的污垢時請使用柔軟、乾燥的布料，請勿使用強力化學溶劑，如稀釋劑或強力清潔劑來擦拭，以避免造成變形或褪色等損壞。

VR18 的設計為專供室內使用之記錄器（無防水功能），不適合裝置在任何危險區域，使用時請避開可能的碰撞、震動以及電磁干擾的區域（例如馬達或變頻器的雜訊干擾區域）。

VR18 適用的環境條件如下：

污染程度 LEVEL II IEC1010-1 (EN 61010-1)

溫度 5 ~ 50 °C

溼度 20 ~ 80% RH(非凝結狀態下)

電源 90 ~ 250 VAC, 50/60 Hz, 11 ~ 18 VDC 或 18 ~ 36 VDC

盤面型

圖 2-1 正面圖

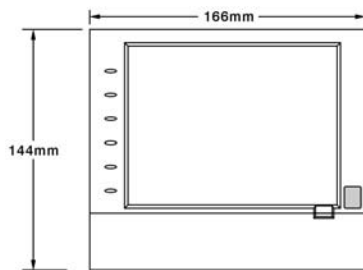


圖 2-2 側面圖


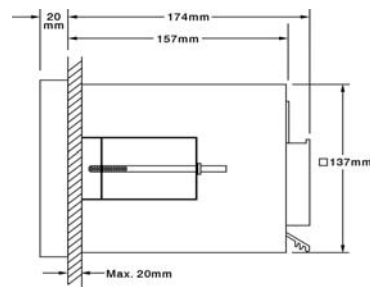


圖 2-3 盤面開孔(標準 DIN 尺寸 138mm x 138 mm)

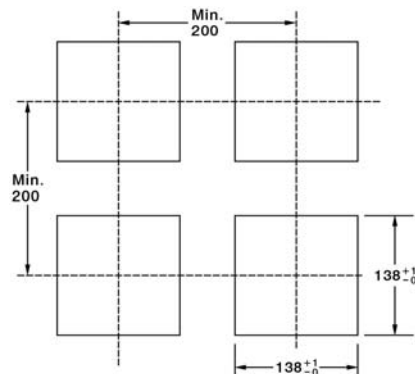

注意事項：

⚠ 請勿過度鎖緊固定架螺絲，以避免外殼變型、損壞。

◆ 裝置記錄器無架設角度的限制。

桌上型/手提式

如果您所使用的記錄器是桌上型（手提式），開箱後請依下述方法安裝 MK184 配件(包括 2 個塑膠耳朵，1 個手把和 2 個墊腳)。

首先將右耳扣環 FV-R 附在鐵殼的右邊，然後按照圖 2-4 至 2-8 所指示的方向將右耳卡入鐵殼右邊的孔內，將卡榫弄直，確認右耳扣環緊密附著在鐵殼上，然後使用同樣的方法將左耳扣環 FV-L 卡入鐵殼的左邊。

拿起手把，將有文字說明的一面朝前（參考圖 2-9），用兩手將手把的左右臂拉開，並垂直的卡入左、右耳扣環，如圖 2-9，然後將手把轉至底部，同圖 2-10 與 2-11，最後將兩隻墊腳裝入殼底，弄直卡榫，同圖 2-12 至 2-14，現在所有的配件已裝置完成。

圖 2-4

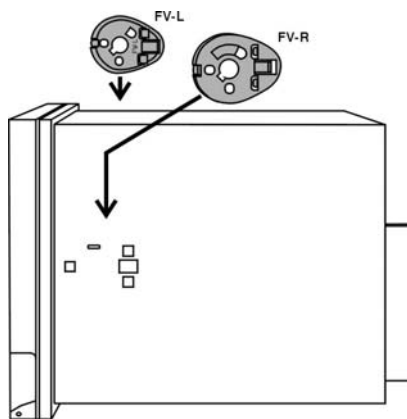


圖 2-5

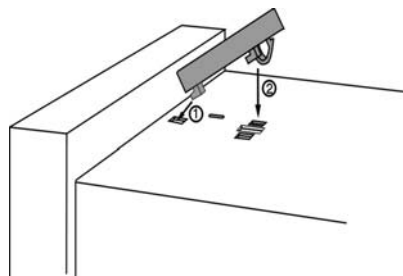


圖 2-6




圖 2-7

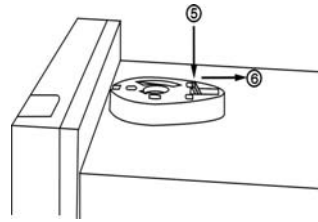


圖 2-8

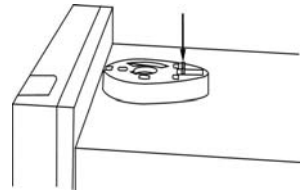


圖 2-9

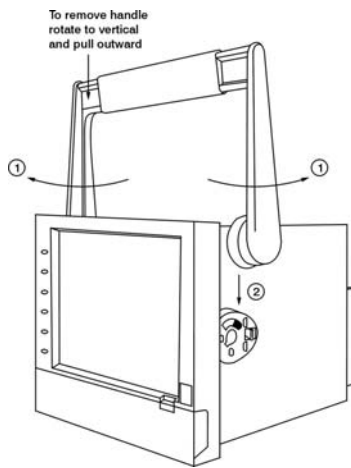


圖 2-10

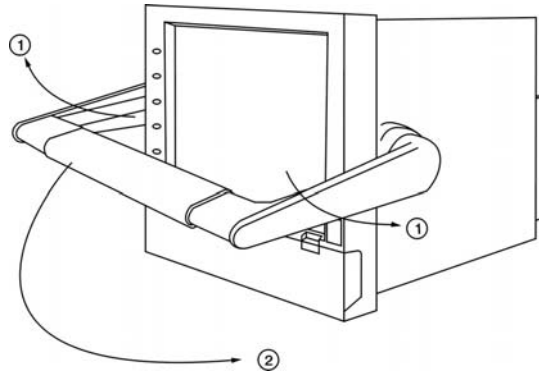


圖 2-11

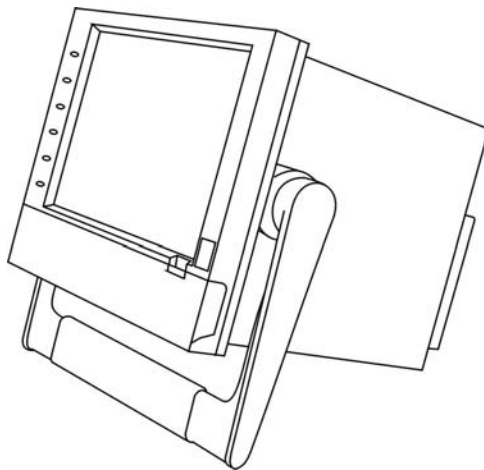


圖 2-12




圖 2-13





圖 2-14



注意事項：

◆若要將手提式改為盤面式，請依上述安裝方式，以相反的順序拆除配件 MK184(包括 2 個墊腳、1 個手把、左/右耳扣環)，然後再裝上固定架。

2.3 輸入和輸出設定與說明

2.3.1 類比輸入卡(產品序號 AI 181、AI 182、AI 183)：

AI 181、AI 182 與 AI 183 是 1、2、3 點通道的類比輸入卡，類比輸入卡可接受多種不同型式的訊號輸入，包括熱電偶(J、K、T、E、B、R、S、N、L 型)、PT100、mV、mA、V 輸入等 (需在輸入卡上調整 JUMPER&DIP SWITCHES)。

設定輸入訊號型式時請參照圖 2-15 或類比輸入卡上之對照圖貼紙，調整 JUMPERS 和 DIP SWITCHES。設定完成後，將卡片插入擴充槽後再打開電源，記錄器會自動偵測和顯示 I/O 卡設定好的訊號輸入型式，另外，也會在"系統資訊"中顯示輸入通道來自於哪個擴充槽。類比輸入卡的出廠設定為 4~20mA 輸入。

圖 2-15 類比輸入卡 Jumper 及 DIP Switches 對照表

JUMPER AND SWITCH SETTING			V1.9								OTA182C			
FUNCTION			MINI-JUMPER			DIP SW SETTING								
			J1	J2	J3	1	2	3	4	5	6	7	8	
UNIT	°C	T/C or RTD	—			■								
	°F	T/C or RTD	—				■							
	mV	0 ~ 60mV	—											■
		0~1000mV	—				■							■
	V	0 ~ 5V	—							■				■
		1 ~ 5V	—						■					■
		0 ~ 10V	—						■					■
	mA	0 ~ 20mA		—			■	■						■
		4 ~ 20mA		—					■	■				■
	THERMOCOUPLE	J						■						
K								■						
T							■	■						
E									■					
B								■						
R								■	■					
S								■	■	■				
N													■	
L													■	
TC1									■					
RTD	PT100								■	■				
	JPT100								■	■	■			
	RTD1								■	■	■			

3-wire RTD	2-wire RTD	0~60mV, T/C	0~1000mV, V, mA

類比輸入卡(產品序號 AI 183V)：

AI 183V 是 3 點通道的電壓訊號輸入卡，電壓輸入卡可接受訊號型式包括： $\pm 60\text{mV}$ 、 $\pm 20\text{mA}$ 、 $\pm 2\text{V}$ 、 $\pm 20\text{V}$ 。

設定輸入訊號型式時請參照圖 2-16 或正負類比輸入卡上之對照圖貼紙，調整 JUMPERS 和 DIP SWITCHES。設定完成後，將卡片插入擴充槽後再打開電源，記錄器會自動偵測和顯示 I/O 卡設定好的訊號輸入型式，另外，也會在“系統資訊”中顯示輸入通道來自於哪個擴充槽。正負類比輸入卡的出廠設定為 $-20\text{mA}\sim 20\text{mA}$ 輸入。

圖 2-16 正負類比輸入卡 Jumper 及 DIP Switches 對照表

FUNCTION		MINI-JUMPER			DIP SW SETTING							
		J1	J2	J3	1	2	3	4	5	6	7	8
-60 ~ 60 mV			■			■	■	■		■		
-2 ~ 2 V		■								■	■	
-20 ~ 20 V			■			■				■	■	
-20 ~ 20 mA				■			■			■	■	

-60~60mV **-2~2V, -20~20V, -20~20mA**

Terminal block diagrams showing connections for the two settings. The first diagram shows terminals R, A, B, G with a voltage source between A and B. The second diagram shows terminals R, A, B, G with a voltage source between A and B and a current source between B and G.

2.3.2 數位輸出卡(DO181) / 6 點警報輸出

數位輸出卡包含 6 組 N.O.接觸型式的繼電器接點（額定值為 5A/240VAC），將數位輸出卡插入擴充槽，通上電源，記錄器就會自動偵測到數位輸出卡的存在，並可在組態設定的“系統資訊”(System Info)模式中顯示輸入卡類型（DO），以及此卡是固定在哪一個擴充槽等等資訊。需要設定輸出卡時請參考章節 4.1 通道“事件”與“工作”設定。

2.3.3 數位輸入卡(DI181)

每張數位輸入卡包含 6 組事件通道（Event 1, 2, 3, 4, 5 & 6），將輸入卡插入擴充槽，然後通上電源，記錄器就會自動偵測到數位輸入卡的存在，並可在組態設定的“系統資訊”中顯示輸入卡類型（DI），以及此卡是固定在哪一個擴充槽等等資訊。

2.3.4 類比輸出卡(AO183I, AO183V)

AO183I 為 3 點通道的電流訊號輸出卡，AO183V 為 3 點通道的電壓訊號輸出卡，作為 PV 值再傳送用（至其他可接受線性訊號之裝置）。

2.3.5 24VDC 輔助電源卡 (AP181)


每張輔助電源卡可提供六組傳送器電源，輸出額定值： $24\pm 1\text{VDC}$ ，最大 180mA，每個通道 30mA。

2.4 輸入/輸出卡配線說明

⚠ 配線注意事項

- (1) 配線前請務必確認所使用之（最大）電源未超過電源端子所標示的電源額定值。
- (2) 安裝盤面式記錄器時，建議您於記錄器電源端額外加裝保險絲（2A/250VAC）及電源開關（2A/250VAC）。
- (3) 注意，勿過度鎖緊接線端子的螺絲，鎖螺絲的扭力請不要超過 0.7 N·m（6.3 Lb·in 或 7.1 Kg F·cm）。
- (4) 除了熱電耦需搭配專用導線外，其他配線請用 18AWG 以下的銅導線（建議花芯線較耐繞曲）。
- (5) 使用本記錄器前，請確實接好接地導線（線徑 1.6 mm 以上），以作好接地保護。

圖 2-17 記錄器後側端子圖

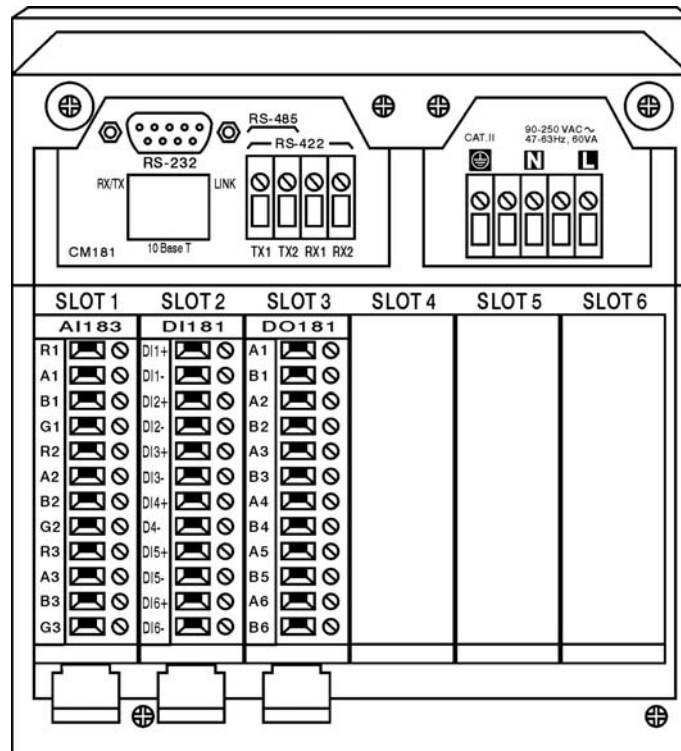

注意：

- ▲ 記錄器的插槽最多只可擴充到 6 張卡，可以根據使用者需要安裝類比輸入卡、電壓輸入卡、數位輸出卡、數位輸入卡、24VDC 輔助電源卡等。

圖 2-18 類比輸入卡 (AI181/182/183) 接線示意圖

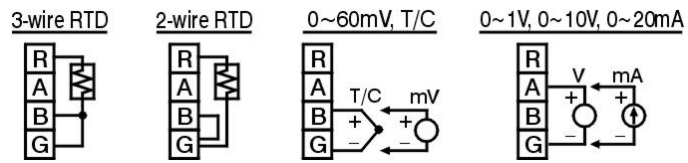


圖 2-19 電壓輸入卡 (AI181V/182V/183V) 接線示意圖

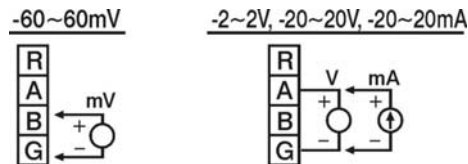


圖 2-20 數位輸出卡 (DO181) 接線示意圖

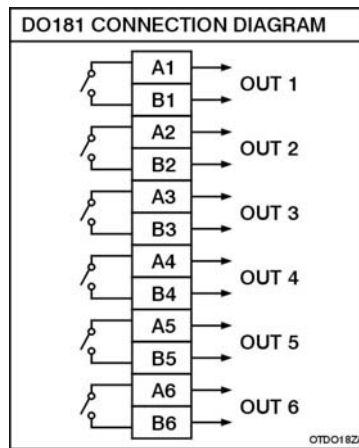


圖 2-21 數位輸入卡 (DI181) 接線示意圖

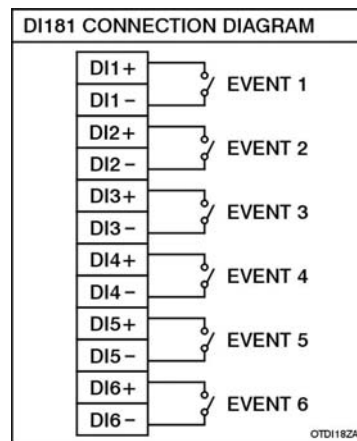


圖 2-22 類比輸出卡 (AO183I&AO183V) 接線示意圖



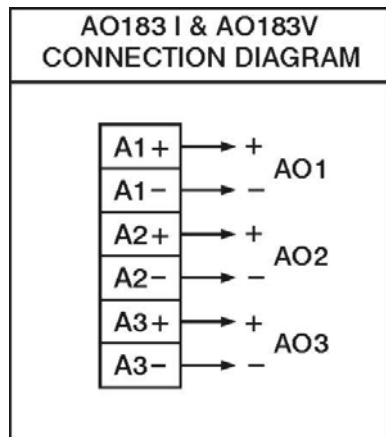


圖 2-23 24VDC 輔助電源卡(AP181)接線示意圖

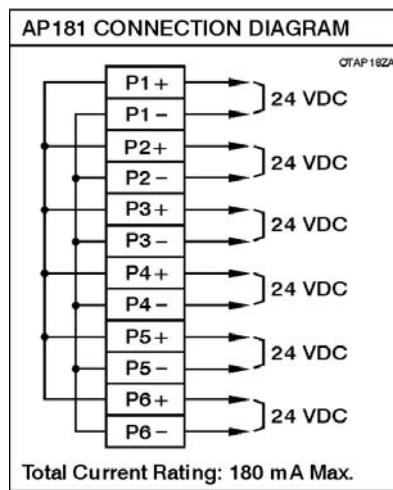

2.5 RS232, RS422, RS485 接線示意圖

圖 2-24 RS232 接線示意圖

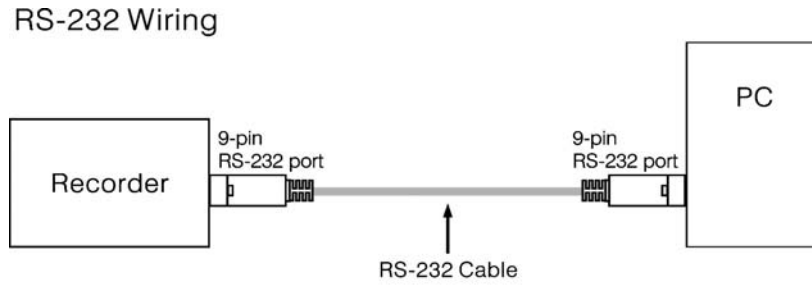

Configuration of The RS-232 Cable

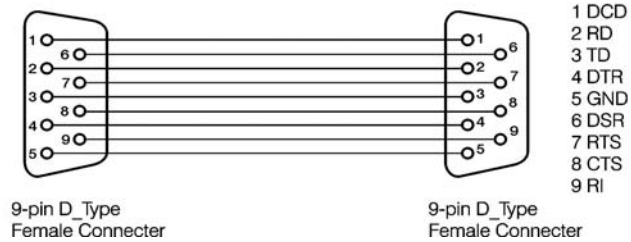


圖 2-25 RS422 接線示意圖


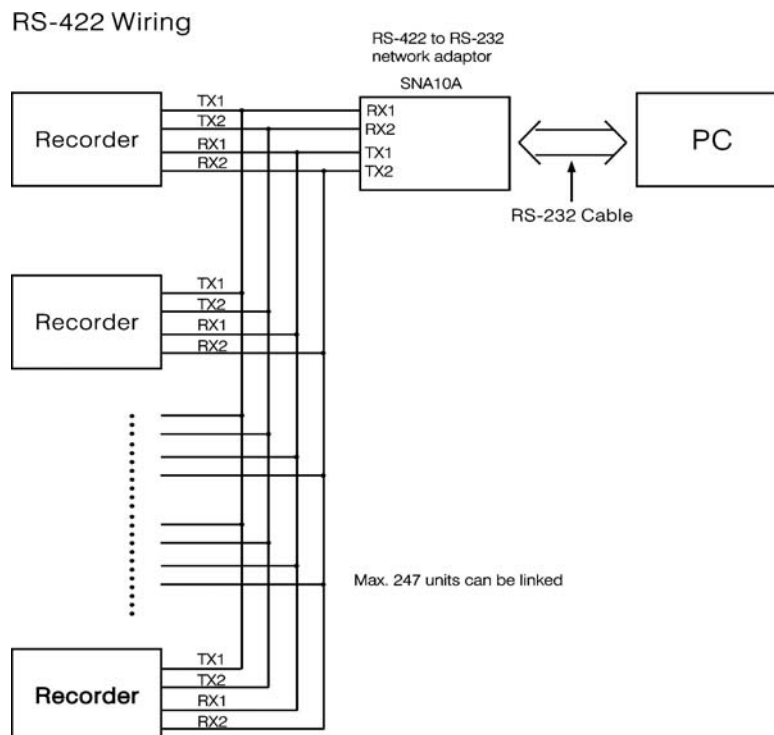


圖 2-26 RS485 接線示意圖

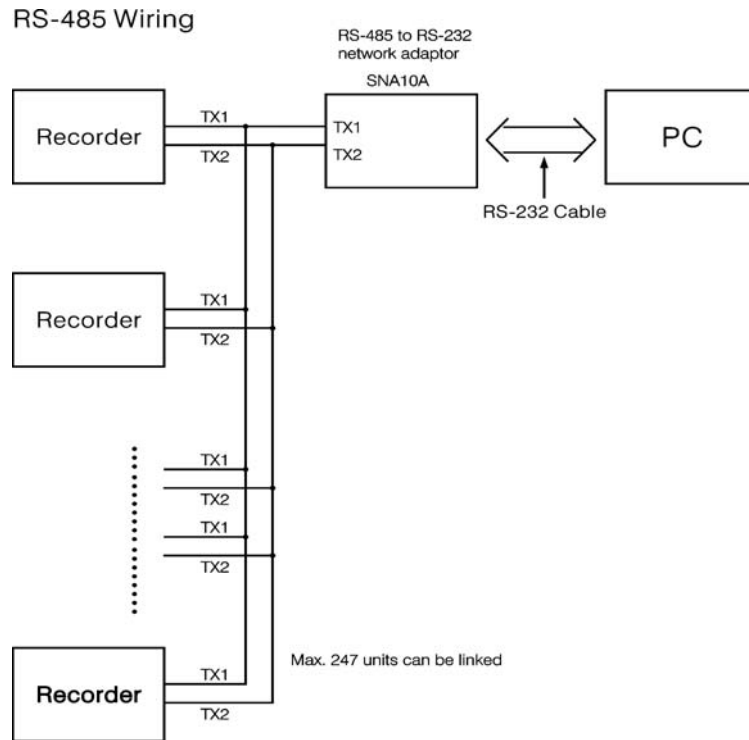

2.6 安裝 CF 卡

記錄器在出廠時即附有 CF 卡（請參考型錄），若您需要較大容量 CF 卡，可以向經銷商詢購。如果您想就近購買，基於穩定性的考量下，我們建議選購“SanDisk”品牌。

安裝：先將 CF 卡置入 CF 槽內“到底”，並將卡槽右邊的黑色推桿向右扳平。

取出：先將黑色推桿扳直，並垂直地壓下推桿；推桿的機構連動會將 CF 卡稍微向外推出，此時可用手直接將 CF 卡取出。

注意事項：

◆ 要讀取 CF 卡的資料之前，需先於電腦上安裝觀察者一號或二號軟體，接著將 CF 卡讀卡機（CF Card Reader）連接電腦的 USB 連接埠，再將 CF 卡插入讀卡機中。

⚠ 當您在插入或拔出輸入或輸出卡時，請先將記錄器電源關閉，請勿在熱機狀態（電源打開時）任意插拔 I/O 卡，以免當機。


3. 基本操作

完成記錄器的安裝、配線後，打開電源，跑完開機畫面後，按下記錄器左側任何一個鍵，螢幕的左方就會出現**頁面**、**模式**、**歷史**、**事件**、**狀態**和**離開**六個文字方塊。

另外，打開記錄器正面下方的前面蓋板，螢幕的下方（按鍵上方）會出現另外五個：**下載**、**清除**、**操作**、**組態**和**關機**等文字方塊。這十一個按鍵提供您操作與設定記錄器時使用。

而螢幕右上方的的小圖示則分別顯示警報（喇叭圖形）、evnt、mem、CF 和日期 / 時間等訊息。

圖 3-1

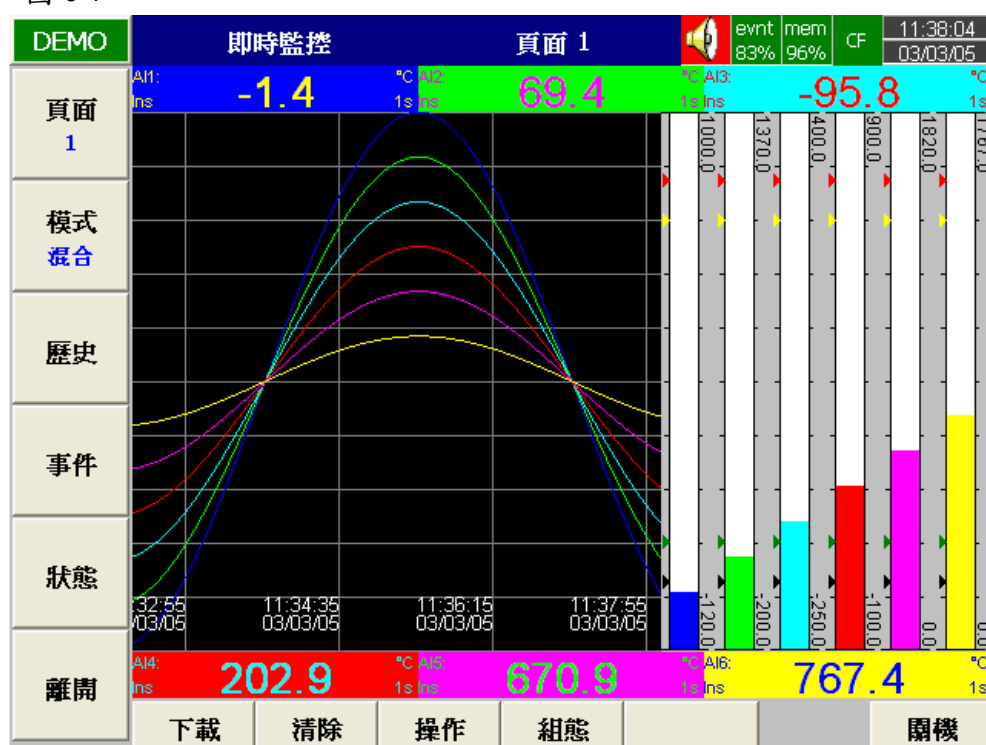

按鍵說明：

3.1 頁面

“頁面”指的是記錄器上的顯示畫面，本記錄器最多可以設定 6 組頁面，每組頁面最多可顯示六筆通道的資料。每筆通道可以用來顯示量測到的數值或經過數學計算的結果值，如果您所記錄的通道數多於六筆（一個畫面最多能顯示六筆通道），您可以按“頁面”鍵切換畫面。

繼續按“頁面”鍵，切換到“頁面/全部”時，則螢幕會秀出所有(Enable)的通道(參考圖 3-2)。

圖 3-2

DEMO	即時監控						全部	evnt 83%	mem 96%	CF	11:48:26
頁面 全部	AI1	AI2	AI3	AI4	AI5	AI6					
	972.0 °C	1206.5 °C	280.8 °C	637.5 °C	1198.2 °C	1023.4 °C					
	AI7	AI8	AI9	AI10	AI11	AI12					
	620.4 °F	847.1 °F	88.2 °F	661.1 °F	1559.7 °F	1569.4 °F					
	AI13	AI14	AI15	AI16	AI17	AI18					
	79.80 %	69.87 %	59.93 %	40.07 %	30.13 %	20.20 %					
事件	Math1	Math2	Math3	Math4	Math5	Math6					
	-351.7	-359.4	-192.6	23.6	361.5	546.0					
狀態	Math7	Math8	Math9	Math10	Math11	Math12					
	79.8	69.9	59.9	90.1	80.1	70.2					
離開	下載	清除	操作	組態							關機

3.2 模式

按“模式”鍵，可以選擇不同的顯示畫面包括混合、曲線、長條、數字等。

混合顯示：混合顯示是記錄器出廠設定的顯示模式，它可以在畫面上同時顯示曲線、長條和數字顯示等三種畫面。

曲線圖：要將混合顯示切換為曲線圖時，只需按一下**模式**鍵，畫面即變成以曲線為主的模式，這些曲線由即時的量測值組成。一個畫面上最多可以顯示6種不同顏色的曲線，每條曲線的顏色可以由使用者自行設定，細節請參照章節**4.2 畫面**。


長條圖：要將曲線圖切換為長條圖，只需再按一下**模式**鍵，畫面即變成長條圖（每個柱狀圖以不同顏色顯示），每個長條的刻度的大小範圍都可以個別設定，細節請參照章節**4.2 畫面**。

數字顯示：按一下**模式**鍵，畫面會出現以不同顏色的數字，再按一下此鍵，它就回到最初混合顯示的畫面。

3.3 歷史資料

按“歷史”鍵，螢幕會顯示出歷史資料形成的曲線圖，若需要在記錄器上尋找歷史資料時，您可以按方向鍵←→移動時間標線到您要查看的時間點。按“縮放”鍵可以縮小或放大歷史資料的時間範圍（1 Sec/Dot, 9min/Page, 1hr/Page, 12hr/Page、1day/Page 或 1week/Page），按“返回”鍵可回到初始畫面。

圖 3-3

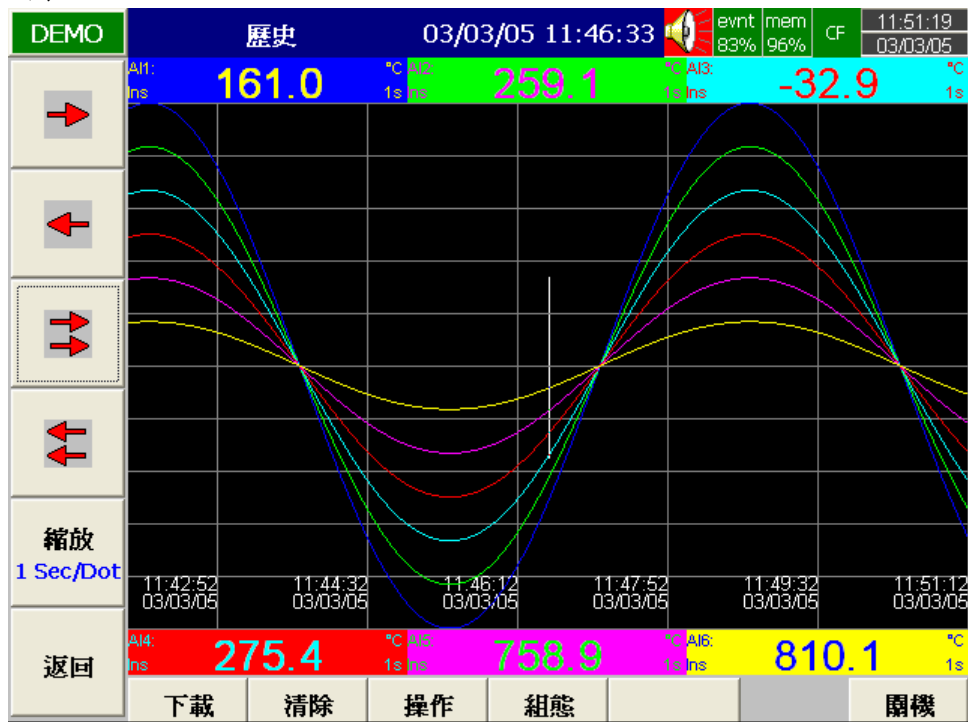

3.4 事件

按一下“事件”鍵，畫面會出現“事件/警報”列表。按“模式”鍵可切換“事件/警報”列表與“報告”畫面，如圖 3-4。

事件/警報

事件/警報列表的上方會出現**確認**、**形式**、**來源**、**發生時間**、**清除時間**，事件或警報發生時的**數值**等欄位。

使用說明：






-  切換“事件/警報”或“報告”的畫面。
-  移到第一筆或最後一筆“事件/警報記錄”。
-  上下移動方向鍵。
-  確認全部的警報記錄（事件記錄不需要確認）。
-  回到上一層畫面。

圖 3-4

確...	型式	來源	發生時間	清除時間	數值
1	系統	關機	02/24 13:09:16		
2	系統	開機	02/24 13:09:16		
3	系統	關機	02/24 13:13:56		
4	系統	開機	02/24 13:13:56		
5	系統	關機	02/24 15:25:59		
6	系統	開機	02/24 15:25:59		
7	系統	關機	03/03 10:43:40		
8	系統	開機	03/03 10:43:40		
9	系統	關機	03/03 11:13:46		
10	系統	開機	03/03 11:13:46		
11	Lo_警報	AI7	03/03 11:13:47		-175.9
12	LoLo_警報	AI7	03/03 11:13:47		-175.9
13	Lo_警報	AI8	03/03 11:13:47		-83.1
14	LoLo_警報	AI8	03/03 11:13:47		-83.1
15	Lo_警報	AI9	03/03 11:13:47		-219.9
16	Lo_警報	AI13	03/03 11:13:47		0.80
17	LoLo_警報	AI13	03/03 11:13:47		0.80
18	Lo_警報	AI14	03/03 11:13:47		17.20
19	Hi_警報	AI17	03/03 11:13:47		82.80
20	Hi_警報	AI18	03/03 11:13:47		99.20
21	HiHi_警報	AI18	03/03 11:13:47		99.20
22	Hi_警報	AI1	03/03 11:14:28		781.8
23	Hi_警報	AI2	03/03 11:14:38		1060.5

如圖 3-4 所示，事件/警報列表會以不同顏色顯示警報的狀況

- 紅色—發生中的警報。
- 綠色—造成警報的原因已解除，已經回復正常。
- 灰色—狀態已經回復正常，且已經使用者確認。

發生時間：是警報狀態開始發生的時間。**清除時間**：是指當警報狀態解除，已回復正常且經使用者確認的時間。一旦發生警報時，螢幕右上角會出現並閃動紅色背景的“喇叭”圖示（警報圖示），一直到警報的原因解除且使用者確認之後，右上角的紅色警報圖示才會消失。

當“清除時間”欄位出現“結束”時，表示該筆警報記錄因前次關閉電源而結束（並非經確認或解除）。

報告：

只有在記錄器韌體有搭配數學運算功能（計數器、累加器、與 FDA21 CFR part II）時才會出現“報告”項目，按“模式”鍵切換到“報告”列表，在“報告”清單中會顯示 1~6 組計數器與 1~18 組累加器、AI1~AI18 的最小/最大/平均、Math1~Math18 數學通道的最小/最大/平均結果值，表列出來。按“報告”鍵可以切換以一日、一週、或一個月為計算基期的報告列表。



按   鍵可以選擇日期、星期或是月份。

圖 3-5

No	Type	Name	Value	Time
1	Channel	AI1	-120.0\1000.0\430.7	23:12:00
2	Channel	Math4	-97.5\801.5\351.0	23:12:00
3	Channel	AI1	923.0\1000.0\979.9	23:12:01
4	Channel	Math4	-97.5\801.5\350.7	23:12:01
5	Channel	AI1	598.2\918.5\773.3	23:12:00
6	Channel	Math4	-97.5\801.5\350.9	23:12:01
7	Totalizer	Tolz1	163393.0	23:12:08

3.5 狀態

按“狀態”鍵可以顯示記錄器使用的數位輸入卡、數位輸出卡、計數器與累加器等目前狀態資訊。按“模式”鍵可以切換“DI”、“DO”、“計數器”或“累加器”等狀態列表顯示出目前“DI”、“DO”、“計數器”或“累加器”的狀態資訊。



3.6 離開

按“離開”鍵時在記錄器左側的頁面、模式、歷史、事件、狀態和離開等六個文字方塊會消失，畫面變成全螢幕顯示。若需要叫出按鍵旁的文字方塊，只需要按記錄器左側任意按鍵即可。同樣在翻開記錄器螢幕下方的前面蓋板，也會在按鍵上方出現下載、清除、操作、組態和關機等五個文字方塊。

3.7 下載

在取出 CF 卡前，請先按“下載”鍵，將記錄器的量測資料從內部記憶體載入 CF 卡。

3.8 清除

當記錄器內部記憶體可用容量減少到 25% 以下時，螢幕右上角的記憶符號  會由綠色轉變成紅色，當事件的可用記憶容量減少到 25% 以下時，螢幕右上角的事件符號  會由綠色轉變成紅色，在上述狀況下，使用者應該按“下載”鍵，將記錄器內的資料包括歷史數據和事件下載到 CF 卡。但若是這些資料對使用者不具意義或不重要時，使用者也可按“清除”鍵將記錄器內部記憶體的資料清除掉。

★ mem 可用儲存空間剩下 11% 時（無插入 CF 卡），記錄器會將內部記憶體內最早的 1

% 資料清除，並覆寫上新的資料。若有插入 CF 卡則記錄器會將 1%（最早的）資料存入 CF 卡，若 CF 卡存滿，則記錄器內部記憶體會開始上述的清除覆寫動作。

- ★ evnt 列表寫滿時（需視“裝置”組態內所設定的事件記錄筆數），記錄器會將內部記憶體內最早的 10 筆事件記錄清除（無插入 Cf 卡），並覆寫上新的事件記錄。若有插入 CF 卡則記錄器會將最早的 10 筆事件記錄存入 CF 卡，若 CF 卡存滿，則記錄器內部記憶體會開始上述的清除覆寫動作。

3.9 操作

按“操作”鍵可以用手動的方式來啟動工作，例如：選擇“警報登錄”可以將警報記錄於事件列表中。在“操作”選項下可以手動啟動多種工作事項，無須事件觸發（請參照章節 4.1 通道有關事件、工作的說明。）詳細設定細節請參照章節 4. 組態設定。

3.10 關機

任意的關閉電源會造成資料遺失和中斷記錄器的動作，因此，我們建議您在關閉電源前請先依正常程序按“關機”鍵，執行關機動作。

3.11 小圖形說明(螢幕的右上方):



警報器 Buzzer：發生警報狀態時，此圖像底色會轉成紅色，警報器（喇叭）圖像會閃動，直到使用者確認警報狀況後，或警報狀況解除後，此圖像才會消失。



事件 evnt：顯示尚可供事件記錄的記憶空間，例如：evnt 61% 表示可用記憶空間還剩 61% 可供記錄事件。（請參考章節 4.4 裝置有關事件/警報的限制與記憶容量的設定。）當可用記憶空間降至 25% 時，此圖像會閃紅光，一直到使用者進行儲存或清除後（按儲存鍵或清除鍵儲存鍵、清除鍵或透過通訊連結將記錄器資料載入電腦後），圖像才會回復綠色（正常狀態）。



記憶體 mem：顯示記錄器內部儲存記憶體尚可使用的記憶空間，當可用記憶空間降至 25% 時，此圖像會閃紅光，一直到使用者進行儲存或清除後（按儲存鍵、清除鍵或透過通訊連結將記錄器資料載入電腦後），記憶容量會恢復原始的百分比，圖像也會顯示正常的綠色。當記錄器內部記憶體（ROM）可用空間剩下 10% 時，記錄器會自動將最舊的量測與事件資料一筆一筆的存入 CF 卡。如果記錄器沒有使用 CF 卡，則記錄器會把內部記憶體最舊的量測資料與事件先清除，再覆寫入新的量測與事件資料。



CF：顯示 CF 卡的狀態。記錄器在未插入 CF 卡時，會顯示一個打紅色 X 的 CF 卡圖像。插入 CF 卡後，紅色 X 的 CF 圖像會消失，並轉換成正常的綠色圖像，圖像上會以百分比顯示 CF 卡可使用的記憶空間，當可使用記憶空間降至 25% 時，圖像會轉成紅色閃動，一直到使用者進行儲存或清除後（按儲存鍵、清除鍵或透過通訊連結將記錄器資料載入電腦後），記憶容量會恢復原始的

百分比，圖像也會顯示正常的綠色。當記錄器上的 CF 卡存滿後，CF 卡的資料會保存下來不會覆寫，記錄器會回頭把記錄器內部記憶體 (ROM) 最舊的量測與事件資料清除，再覆寫入新的量測與事件資料。




日期時間：要設定當地時間，請參照章節 4.5 日期時間。

4. 組態設定

按“組態”鍵可進入組態設定的主畫面，螢幕會顯示「通道」、「畫面」、「工具」、「裝置」、「日期時間」、「安全」、「Demo」和「系統資訊」等組態設定選項，同時記錄器下排按鍵也會出現“存檔”、“載入”、“預設值”，按左排任意鍵，則左方會出現上、下、左、右四個移動方向鍵以及“進入”、“返回”等功能鍵。

圖 4-1

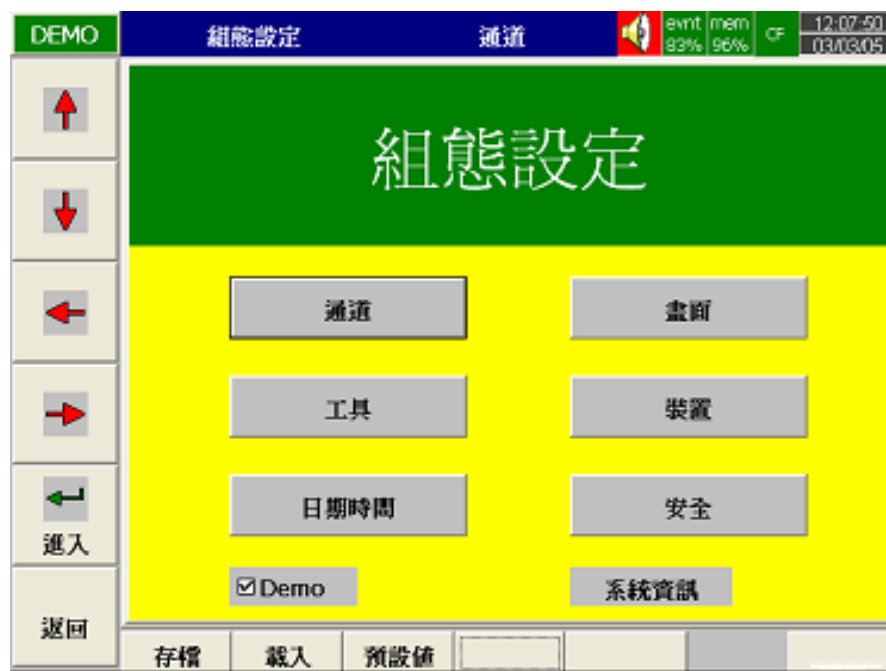

按鍵說明：

進入：首先利用螢幕左側的上、下、左、右方向鍵，選擇欲設定的組態項目（通道、畫面、工具...如上圖 4-1），然後按“進入”鍵進入。

存檔：將記錄器上的組態設定值，存入 CF 卡。當組態設定變更過或第一次在電腦上讀取 CF 卡的量測與事件資料時，請記得在 CF 卡取出前按“存檔”將記錄器的組態載入 CF 卡。

載入：將 CF 卡上的組態設定值載入記錄器。

預設值：如果您在記錄器組態設定有錯誤時，可以按“預設值”鍵，記錄器會自動擷取後方插槽內類比輸入卡的組態預設值。

返回：回到上一層畫面。

4.1 通道（類比輸入，數位輸入、類比輸出、數學通道）

類比輸入

進入組態設定主畫面後，選擇**通道按進入**鍵，即可進入通道設定的模式。首先出現的是類比輸入的通道（AI），您可以按螢幕下方的 **<** **>** 鍵可以切換通道。另外，螢幕左側的方向鍵 **↑**、**↓**、**←**、**→** 鍵則是用來移動藍色區塊到欲設定的欄位。完成 4.1 至 4.8 等組態項目後，記得要按“返回”鍵，跳回到即時監控的畫面，這時設定好的組態才會儲存起來。

說明：當您用左側的方向鍵藍色區塊到欲設定的欄位時，欄位內的文字會反白，字元尾端會顯示閃動的終止線。

圖 4-2



名稱欄：用來定義每一通道的名稱。名稱欄可輸入六個數字或英文字元，切換到名稱欄按“進入”鍵，螢幕會出現小鍵盤，按“BackSP”（下排）可清除不要的文字，按“選擇”鍵（在左側）來選取數字、英文字，按“Caps”鍵（在左側）可以切換大小寫字型。

說明欄：本欄位輸入可以加註通道的意義或性質（最多可輸入 26 個英文字元）。

方法欄：設定記錄取值的方法。記錄器中已預設五個選項，使用者可依需要選取“關閉”、“即時”、“平均”、“最小”、“最大”等取值方法。

關閉：不記錄。（在“畫面”組態下設定的通道“關閉”為通道不顯示，但依舊會記錄）

- 即時：記錄採樣區間內最末一個值。
- 平均：記錄採樣區間內所有採樣值的平均數。
- 最小：記錄採樣區間內最小的採樣值。
- 最大：記錄採樣區間內最大的採樣值。

速度：設定記錄量測值的速度，記錄器內可選擇 1/2/5/10/30/60/120 秒記錄一點等七個選項。

偏移值：修正感測器的量測值。

例如：於本欄輸入“-1”，則記錄器上會顯示出“量測到的數值-1”的修正結果值，以此類推。

倍增值：以乘數倍率修正感測器的量測值。

例如：倍增值輸入為“1.8”則記錄器上會顯示出“(實際值+偏移值)×1.8”的修正結果值，以此類推。

★注意：倍增值修正時毋需修正時，欄內數值應為“1”。

感測器：自動偵測並及顯示輸入卡所設定的輸入訊號型式（參考 2.3 設定輸入和輸出卡）：如 V、mV、mA、T/C (J、K、T、E、B、R、S、N、L)、PT100、JPT100 等。
客戶無指定時，輸入卡出廠設定為 4~20mA 輸入。

單位：工程單位（自動偵測°C/°F/mV/mA 等）。

Range 範圍：

A：電流 / 電壓輸入範圍可自由設定，通常感測器常設定的訊號範圍為 1-5、0-5 或 0-10V 的電壓訊號或 0-20mA、4-20mA 的電流訊號 (I/O 卡的 JUMP & DIP SWITCH 需先設定)。

B：T/C 或 PT100 訊號輸入可於此欄位選擇無小數或一位小數顯示。

Scale：(電流或電壓訊號輸入)

單位：設定量測值單位(T/C 及 PT100 只能設定°C 或°F)。

Low：設定量測範圍低限值。

High：設定量測範圍高限值。

- 低限值與高限值欄位在設定為線性訊號輸入時才會出現。
- 低限值與高限值得用來對應輸入訊號；例如輸入訊號為 0~5V，設定低限值得為 0.0，高限值得為 150.0，表示 0V 訊號對應低限值得 0.0，5V 對應高限值得 150.0，而訊號 1.5V 時則會對應顯示 45.0 的量測值。
- 高 / 低限值得可設定的值範圍不可超過 45536 (或 4553.6 或 455.36 或 45.536 或 4.5536 或 0.45536)。
- 若所對應的量測值有小數；例如小數點 2 位 (*.*) 則低限值與高限值

均需設定為兩位小數的數值。

- 高 / 低限值的小數位數需一致。

事件：事件欄通常被拿來作警報的功能。不過，事件工作欄內，還包含其他許多可供應用的工作選項包括事件登錄、儲存暫停或啟動、啟動或鎖定 DO、啟動計數器、累加器、計時器等等。

型式：H、L、HH、LL、R、r 等六種啟動工作或警報的事件型式。

H：高點，當實際值高於設定值時啟動警報或工作。

L：低點，當實際值低於設定值時啟動警報或工作。

HH：第二高點，可設定第二組高於 H 高點的設定值，提供雙重警示功能。

LL：第二低點，可設定第二組低於 L 低點的設定值，提供雙重警示功能。

R：上升（增加）速率，即實際值上升（增加）的速度，當實際值增加的速度大於設定的上升速度時，就會啟動警報或工作。舉例來說，某製程設定每 1 秒上升數值 100，如果製程中每秒上升的實際值大於 100，就會啟動警報或工作。

r：下降（減少）速率，即實際值下降（減少）的速度，當實際值降下的速度大於設定的速度時，就會啟動警報或工作。

設定值：設定啟動工作 1，工作 2 的值。

工作 1/工作 2：當所設定的條件(H/L/HH/LL/R/r)發生時，記錄器啟動的動作。

例如：當系統實際溫度高於 50°C 使用者要紀錄器的蜂鳴器響（嗶嗶聲），這時需先設定“H”，設定值輸入 50，工作依選擇“蜂鳴器發聲”。

- 本記錄器上，每個通道的可以設定四個事件，每個事件可設定去執行兩個工作。
- 要注意的是：在事件下設定的工作和按“操作”鍵執行工作是不同的，前者必須要以事件的發生來啟動，而後者是用手動直接操控。

工作項目（可選擇）：

無動作：不動作。

警報登錄：記錄警報的發生（在事件/警報列表上）。

事件登錄：記錄事件的發生（在事件/警報列表上）。

儲存暫停：停止記錄量測值。

儲存啟動：開始記錄量測值。

蜂鳴器發聲：啟動記錄器蜂鳴器的聲音（嗶嗶聲），可按任意鍵停止。

DO 鎖定 On：啟動數位輸出固定在 ON 狀態（可指定 DO1~DO6，須手動解除）。

DO 鎖定 Off：啟動數位輸出固定在 OFF 狀態（可指定 DO1~DO6，須手動解除）。

DO 程序：當所設定的事件 H、L、R 等等條件發生時啟動數位（Relay）輸出 ON，
但當狀況回復後數位（Relay）輸出即 OFF（可指定 DO1~DO6）。

計時器啟動：啟動計時器（可選定 Timer1~Timer6）。

計時器關閉：關閉計時器（可選定 Timer1~Timer6）。

累加器預設值：以預設值為基數開始累加（可選定 Tolz1~Tolz18）。

累加器歸零：以"0"為基數開始累加（可選定 Tolz1~Tolz18）。

累加器開啟：啟動累加功能（可選定 Tolz1~Tolz18）。

累加器關閉：關閉累加功能（可選定 Tolz1~Tolz18）。

計數器預設值：以預設值為基數開始計數（可選定 Cont1~Cont 6）。

計數器歸零：以"0"為基數開始計數（可選定 Cont1~Cont 6）。

計數器累加：累加計數（可選定 Cont1~Cont 6）。

計數器遞減：遞減計數（可選定 Cont1~Cont 6）。

報告登錄：將計數器與累加器的結果匯入報告清單，參考 3.4 事件列表。

最小/最大/平均值報告更新：此功能可更新最小/最大/平均值報告（在報告功能下可
將類比輸入或數學通道之最小/最大/平均值登錄於報
告列表中）。

遲滯：為避免動作過於頻繁，可於本欄位設定遲滯帶 0.1% ~10% 數位輸出的 Relay 延遲
反應的區間（×輸入訊號滿刻度的範圍值）。

注意：

◆ 記錄器採樣的速率固定為每 200mS 一次，即每秒採樣五次。

例如：如果記錄方法設定為"即時"，記錄速度設定為"1S"，則記錄器所記錄的量測值為一秒內採樣的五個值中的第五個數值。若採樣方法設定為"平均"，則記錄器會先將一秒內採樣的五個值加以平均再記錄平均後的數值。

	採樣速率	記錄（歷史曲線）	顯示（即時連線）
關閉	—	—	—
即時	200 m sec	取最後一個量測值	5 個量測值的最後一個
平均	200 m sec	取量測值的平均數	5 個量測值的最後一個
最大	200 m sec	取量測值的最大值	5 個量測值的最後一個
最小	200 m sec	取量測值的最小值	5 個量測值的最後一個

◆ 儲存新的組態，只需按"返回"鍵回到組態設定的主畫面，即可儲存所設定的參數。

◆數位輸出卡（6 Relays）可在“工作一”，“工作二”欄位內設定 DO1~DO6 的 Relay，若不確定記錄器是否有選用 DO 卡，可進入“系統資訊”確認擴充槽是否有 DO 卡。

數位輸入通道 (DI)

按“DI”鍵可進入數位輸入通道設定模式（圖 4-3），可設定通道名稱、說明、事件的型式與工作等，按下排方向鍵“<”、“>”則可切換所要設定的 DI 通道。

類比輸出通道

按“AO”鍵可進入類比輸出通道設定模式。若使用 AO183I 電流輸出，則可在此設定畫面下設定類比輸出訊號為 0~20mA 或 4~20mA；若使用 AO183V 電壓輸出，則可在此設定畫面下設定類比輸出訊號為 0~5V，1~5V 或 0~10V。

數學輸入通道 (選配)

按“數學”鍵可進入數學通道設定模式（圖 4-4），數學通道設定中除多了**數學運算式的設定欄位**外，其餘均與類比輸入通道的設定方式接近：可設定名稱、說明、型式、登錄方法、速度、單位、Scale Low、Scale High 等。進入數學運算的欄位畫面會出現數學運算設定方塊（圖 4-5），裡面包含了“來源”、“運算元”設定欄位以及一個“數字鍵盤”。數學運算的來源包括所有可用的 AI/AI183V/AI183I 輸入卡的通道、數學通道以及計數器通道；運算元內則包含許多數學的函數式，詳細內容請參考 **6.數學運算**。運用通道來源、運算元以及數字小鍵盤可讓使用者設定數學運算方程式，按下排方向鍵“<”、“>”則可切換所要設定的數學通道（Math1~Math18），按**返回**鍵則可將所設定的數學運算功能儲存。

圖 4-3


No	型式	工作 1	工作 2
1	No	警報登錄	無動作
2	No	警報登錄	無動作

圖 4-4



若訂購有數學功能之機種（選配），您可在“組態”的“通道”設定畫面下進入數學通道的設定功能，數學通道中的方程式可從量測值導出或計算出變數。求算出來的結果值可以顯示與儲存下來。數學運算（方程式）可設定之最大長度須在 36 字元內。

圖 4-5

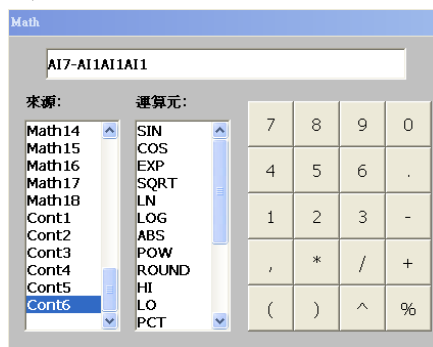

數學運算式與設定範例

運算式	說明
+	加法
-	減法
*	乘法
/	除法

SIN(x)	$\sin(x)$
COS(x)	$\cos(x)$
EXP(x)	e^x
SQRT(x)	x 的平方根
LN(x)	$\log_e(x)$
TG(x)	三角函數 $\tan(x)$
CTG(x)	三角函數 $1/\tan(x)$
ASIN(x)	三角函數 $\text{Sin}^{-1}(x)$
ACOS(x)	三角函數 $\text{Cos}^{-1}(x)$
ATG(x)	三角函數 $\text{Tan}^{-1}(x)$
LOG(x)	計算以 x 為底的對數值
ABS(x)	x 的絕對值
SQ(x)	x^2
ROUND(x)	最接近 x 的整數值
HI(x,y)	x,y 兩值中之最大值
LO(x,y)	x,y 兩值中之最小值
INV(x)	$1/x$
PCT(x,Hi,Lo)	x 值佔(Hi-Lo)值之百分比, x: 特定值, Hi: 較大值, Lo: 較小值
x%y	x 除以 y 後所得之餘數
x^y	x^y

注意：

▲ 數學通道須於訂購時選購具備數學、計數器及累加器之機種或訂購數學功能之 Boot ROM，自行更換（需拆開外殼）。

數學運算範例

舉例來說，假如記錄器有三個類比輸入通道，和一個數學運算通道，現在，你需要在設定好三個類比輸入通道後，設定這個數學運算通道。

- 1、在通道設定模式中（參考章節 4.1 通道設定）按“數學”鍵，進入數學運算通道設定畫面。
- 2、定義此通道的名稱、說明、取值方法、記錄速度，並輸入你所需的數學式/程式。
- 3、進入畫面設定模式（參考章節 4.2 畫面設定），定義顯示模式、曲線方向、背景顏色，如果畫筆的第 1、2、3 通道，分別代表三個類比輸入通道時，您可以選擇 4 號當作數學運算通道的記錄。
- 4、在 4 號畫筆的“通道”欄位下按“進入”鍵，選擇“MATH1”。
- 5、定義顏色、粗細、顯示上限與下限。
- 6 按“返回”鍵兩次，回到一開始的顯示畫面，所有設定的組態就可以儲存起來，數學運算功能也會開始運作。

4.2 畫面

按**返回鍵**，回到組態設定的主畫面，利用左側方向鍵移動至“畫面”選項，按“進入”鍵即可進入畫面的設定模式。記錄器最多可編排六頁畫面，每頁畫面最多可編排六個通道。

模式：畫面顯示模式，可選擇混合、曲線、長條、數字或關閉等模式（參考圖 4-6）。

方向：曲線顯示方向，可選擇垂直曲線或水平曲線顯示。

背景：曲線顯示的背景顏色，可選擇白色或黑色。

畫筆：設定畫筆所代表的通道、顯示的顏色、線條粗細、顯示的低限值（Low）、顯示的高限值（High）。

圖 4-6



通道：通道欄中可設定類比/電壓輸入通道或具數學通道，也可以選擇“關閉”（僅不顯示但不停止記錄）。

顏色：通道的顏色（曲線、長條或數字顯示的顏色等）。

粗細：設定曲線的粗細，1-細線，2-中等線，3-粗線。

Low：通道顯示的低限值。

High：通道顯示的高限值。

狀態列：為方便使用者監看累加器、計數器、數位輸入或輸出通道的動作狀態，可在“狀態列”內作狀態顯示設定。例如，在“累加器”與“計數器”欄內設定“啟動 1~6”後，畫面底部會出現累加器 1~6 通道與計數器 1~6 通道的狀態列（圖 4-7）。

注意事項：

- ◆ 畫筆欄內的顯示 **Low**、**High** 與 **Scale Low**，**Scale High**：舉例來說：如果訊號輸入型式為 0-10V 電壓，Scale Low=0.00，Scale Hi=100.00 時，為了有更好的視覺辨識效果，

我們可以設定畫筆欄內的顯示 Low=0.00，High=50.00，如此螢幕上顯示的範圍便會限定在 0.00 到 50.00 範圍區間。

- ◆ 顯示的小數點設定在"通道"（每個通道可單獨設定），而不是在"畫面"下設定：


T/C 及 PT100 在"Range"內選定，可選定一位小數或沒有小數點。

其他線性訊號在 scale 的 Low&High 中設定（參考 P.39）

- ◆ 每頁畫面的通道可不按順序排列，例如：有 6 個類比輸入通道與 18 個數學通道可設定第一頁畫面僅顯示 AI2、AI5 與 Math14 三筆通道。

- ◆ 小數點需在通道設定模式的 Scale Low 與 Scale High 欄位中定義。

圖 4-7

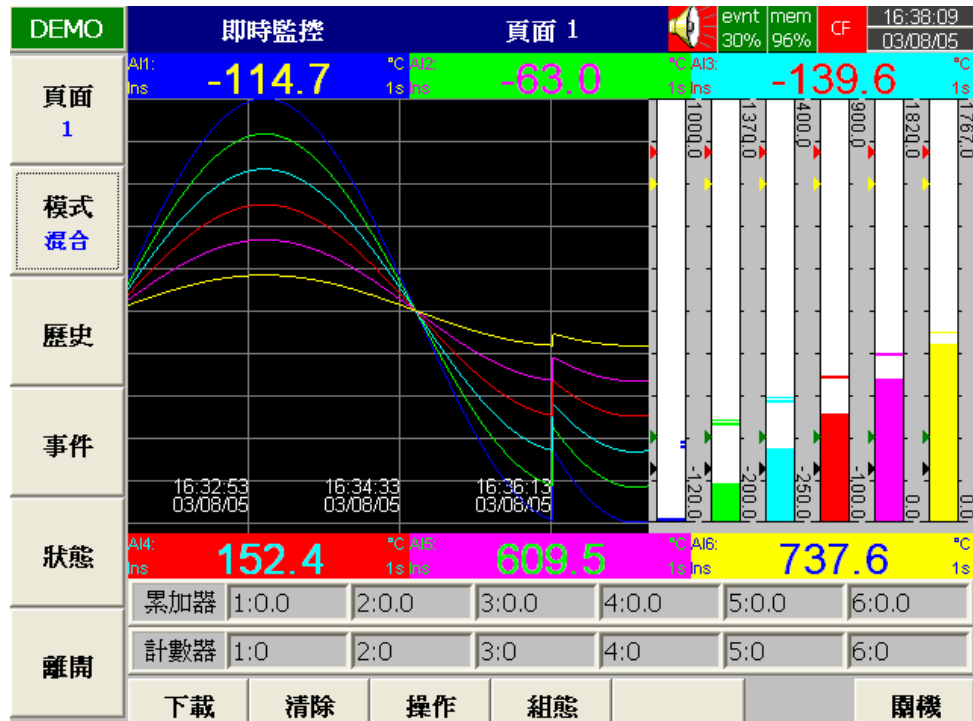

4.3 工具—計時器、計數器、累加器

按**返回鍵**回到組態設定的主畫面，利用左側方向鍵移動至”工具”選項，按”進入”鍵即可進入工具的設定模式。(參考圖 4-8)，在這裡可以設定計時器、計數器、累加器的組態。

◆需選配數學計算版本，才具備計數器、累加器為選配功能。

● 計時器：

按 **<**、**>** 鍵，選擇計時器 1~計時器 6。

圖 4-8



型式：倒數計時、重複倒數計時，或日、週、月為基礎的倒數計時。

倒數計時：設定一段倒數時間，如以天、小時、分鐘或秒為單位，非指定某個時間點。

重複倒數：重複執行倒數計時功能。

每日、每週、每月：指定以日、週或月等實際日期作為啟動倒數的起始點。

作用：啟動或關閉。

工作 1、工作 2：設定計時器啟動的項目，詳如章節 4.1 通道之敘述。

計時器與報告範例：某員工希望得到每天記錄資料的最小/最大/平均數，他需要依下列方式到”工具”組態下設定計時器，完成後便可在”事件”中的”報告”列表，可看到如圖 4-9 的報告資料（可用報告鍵切換詳細/每日/每週/每月）報告。

設定方式：

計時器 1~計時器 6

型式：每天 作用：啟動
 時間-----小時：17 分鐘：01
 工作一：(工作項目) 報告登錄 (標的) AI1 MinMaxAve (~AI6 MinMaxAve)
 工作二：重設最小最大平均 (重設歷史資料才能記錄隔天的新資料)

圖 4-9



· 計數器：

按 、 鍵，選擇計數器 1~計數器 6。

名稱：設定計數器的名稱。

說明：計數器的附加說明。

圖 4-10



單位：設定計數單位。

預設值：設定計數器起算的基數。舉例來說；當預設值為"9"，則計數器從"9"開始起跳。

事件：型式—可選"No"無動作、"H"高點啟動、"L"低點啟動。

設定值：設定計數器啟動工作的臨界值。例如：選擇"H"高點啟動，設定值設為"25"，則當計數器數值達"25"時即啟動工作（計數器由DI觸動，可遞增/遞減或由預設值起跳）。

工作 1、工作 2：設定計數器啟動的項目，詳如章節 4.1 通道之敘述。

• **累加器：**

按 、 鍵，選擇累加器 1~累加器 18。

名稱：設定累加器名稱。

說明：累加器的附加說明。

來源：可選擇類比/電壓輸入通道或數學通道作為累加數值的來源。

作用：啟動或關閉累加器。

小數點：設定累加器的小數點位數。

期間：設定以秒、分或小時作為累加期間。

說明：以流量計為例，假使某單位使用之流量計顯示流量為 60 L / HR.則代表一小時才有 60L 的量，此時累加期間需設定以小時為累加期間。

單位：設定累加器單位，如 L、Bar 等。

預設值：設定累加器起算的基數。

事件：型式：可選"No"無動作、"H"高點啟動、"L"低點啟動。

設定值：設定累加器啟動工作的臨界值。例如：選擇"H"高點啟動，設定值設為"999"，則當累加器數值達 999 時即啟動工作。

工作 1、工作 2：設定累加器啟動的項目，詳如章節 4.1 通道之敘述。

圖 4-11



累加器應用範例：

假設有一工廠，每天工廠製程運轉 8 個小時，若希望從記錄器中得到每日、每週與每月的產量報告；首先，需先進入“工具”設定模式，並按照下述方法設定，記錄器便會自動於每天早上 8：30 啟動累加器，執行累加計算功能至下午 17：30 止。

當工作完成後，使用者只要進入事件列表，按“模式”鍵切換“報告”畫面，便可瀏覽累加器計算的結果（此時可按“報告”鍵切換日報告、週報告或月報告列表）。

設定方式：

計時器 1：

型式：每日
時間：小時欄設為 8，分鐘欄設為:30
工作 1：累加器歸零
工作 2：累加器啟動

作用：啟動
標的：Tolz1
標的：Tolz1

計時器 2：

型式：每日
時間：小時欄設為 17，分鐘欄設為:30
工作 1：累加器關閉
工作 2：報告登錄

作用：啟動
標的：Tolz1
標的：Tolz1

累加器：

名稱：xxxx（省略）
來源：AI1 通道
期間：分
事件：

說明：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（省略）
作用：啟動
單位：xxxx
小數點：1
預設值：0.0


No	型式	設定值	工作 1	工作 2
1	H	xxxx	警報登錄	DO 程序
2	L	xxxx	警報登錄	DO 程序

若產量分別是：星期一：990，星期二：1,010，星期三：1,020，星期四：1,020，星期五：980，則切換至週報告的畫面時，則會顯示產量為 5,020。

4.4 裝置

按返回鍵回到組態設定主畫面，選擇裝置，按下進入鍵，進入裝置的設定模式。

圖 4-12

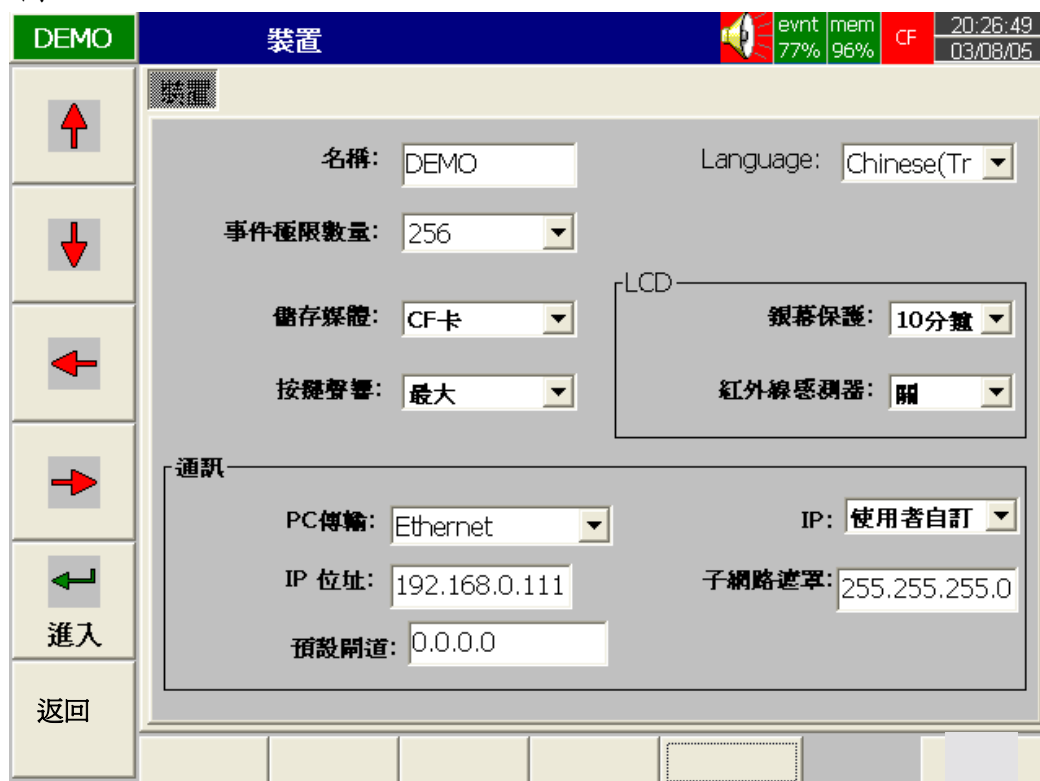

名稱：設定記錄器的名稱（最多 8 個字母）。

Language：設定語言種類，可選擇英文、中文（繁體）、中文（簡體）、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭、日文與韓文等。

事件極限數量：設定儲存事件/警報的數量限制，可選擇 256、512、1024 筆等。

安全：可設定使用者密碼，有一般及 **CFR-21**（選配）兩種安全密碼設定模式。

一般：提供一組共用密碼設定，以 8 個字母為限，一旦於密碼欄位鍵入密碼後，使用者無論是要進入組態、操作等模式或進行下載、清除等工作均須輸入正確的密碼，才能進行。

CFR21：CFR21 安全密碼設定符合 FDA 21 CFR part 11 安全規範。它提供較高階的安全防護功能，可設定 Administrator（管理者）、Supervisor（監督者）、Operator（操作員）三種安全等級，每種安全等級有不同的安全授權（最高階為管理者），CFR21 可設定 30 組使用者名稱（可個別設定不同的密碼）。安全密碼有操作時間的限制，當使用者閒置超過 10 分鐘，便要再輸入一次密碼。在事件列表中亦會記錄在哪個時間，哪位使用者執行過什麼型式的工作（如清除、下載、登入、組態、登出等等），相關細節敘述請參考 4.6 安全密碼與符合 FDA21 CFR part11 規範之功能。

資料下載：

下載且保留—使用 CF 卡將內建 8MB 的記憶體內儲存資料下載，同時並保留記憶體內的資料。

下載並且清除—使用 CF 卡將內建 8MB 的記憶體內儲存資料下載，同時並清除記憶體內的資料。

按鍵聲響：可設定為關閉、最小、中等或最大。

LCD：

銀幕保護：為了延長螢幕壽命，建議將記錄器設定在閒置超過 1、10、20、30、40、50 或 60 分鐘後自動將螢幕關閉。在螢幕保護的狀態下，記錄器仍繼續執行記錄的動作。需喚醒螢幕時，只要按任意鍵即可，此外若警報狀況發生時，螢幕也會自動打開。**記錄器的銀幕保護出廠設定值為 10 分鐘。**

紅外線感測器：

關&開按鍵：銀幕保護的開與關由按鍵控制，舉例來說：銀幕保護設為 10 分鐘，則記錄器在閒置超過 10 分鐘後（無人碰觸按鍵）則 LCD 自動轉暗，按任意鍵則可喚醒銀幕。

關&開 IR：銀幕保護的開與關由 IR 紅外線感測器控制，它可以在 2 公尺左右的距離內感測人員移動，例如：將**感測器**設定在”關&開 IR”，**銀幕保護**設定為 10 分鐘，那麼當使用者離開記錄器（且 2 公尺範圍無人、物移動）達 10 分鐘之久，螢幕會自動休眠，一旦有人靠近記錄器時，螢幕會自動打開，無需按記錄器上任何鍵。

關：IR，開：按鍵—LCD 銀幕的自動關閉由 IR 紅外線偵測器控制（2 公尺前無人、物移動達”銀幕保護”所設定的時間之久），銀幕休眠後須由使用者按任意鍵喚醒。

注意事項：

◆紅外線感測器的啟用必須配合銀幕保護的時間共同設定，它不能單獨工作。然而在不使用感測器的情形下（設定為”關”），銀幕保護的仍可單獨設定使用。

通訊：

PC 傳輸：可選 RS-232/RS-422/RS-485（非標準配備，須於購買時選購），或標準 Ethernet 通訊介面。

PC 傳輸設為”RS-232/RS-422/RS-485”時：

位址：其中 RS-485 可設定從 0 至 247 點。

傳輸速率：可選擇 1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600 或 115,200 等。

資料格式：可選擇 No,8,1 / Odd,8,1 / Even,8,1 三種的資料格式。

PC 傳輸設為”Ethernet”：

IP：可選擇”自動”—由伺服器自動指派記錄器 IP 位址，或選擇”使用者自訂”—由使

用者輸入一個固定的 IP 位址。選擇使用者自訂時，通訊欄內會出現「IP 位址」、「子網路遮罩」、「預設閘道」三個設定欄位：

IP 位址：設定記錄器在網域中適當的位址（不與其他使用中的位址衝突，且為該網路中的合法位址）。

子網路遮罩：設定在網路上正確的子網路遮罩。

預設閘道：內部子網域（群組）之跨域連線時需設定閘道。

注意：

◆如果選擇由伺服器”自動”指派記錄器的 IP 位址，記錄器上的 IP 位址與子網路遮罩的欄位會隱藏起來，但使用者仍可從”System Info”（參考 4.6 系統資訊）中查出記錄器被分派的 IP 位址。若選擇由使用者定義 IP 位址”使用者自訂”，則會顯現 IP 位址與子網路遮罩的欄位，供使用者設定固定的位址。**新設定 IP 位址後，需執行關機重開的動作，設定值才會生效。**

4.5 日期時間

按返回鍵，回到組態設定主畫面。選擇”日期時間”，按”進入”鍵進入”日期時間”設定模式，設定當地的時間按返回鍵後設定值即可生效。

日期格式：可選擇”mm/dd/yy”或”dd/mm/yy”兩種日期格式。

日期/時間：設定當地的日期與時間，設定完成後按應用鍵即可。

夏令時間（日光節約時間）：設定當地的夏令時間，節省能源。

圖 4-12




4.6 安全密碼與符合 FDA21 CFR part11 規範之功能

在 4.4 裝置，可設定安全為“一般”或“CFR-21”模式。選擇“一般”安全模式時，不同的使用者可使用同一組密碼（最多八個字元）。一旦在組態下的“安全”設定好密碼後，無論使用者要進入組態、或執行下載、清除或操作功能時均須先輸入密碼。

如果選擇較高階 CFR21 安全密碼功能，在操作記錄器時會根據 FDA 21 CFR part11 的規範有較多的規則限制。它可個別設定每個使用者 Administrator（管理者）、Supervisor（監督者）、Operator（操作員）等三種不同的安全等級，每種安全等級有不同的安全授權（最高階為管理者），CFR21 可設定 30 組使用者名稱（可個別設定不同的密碼）。安全密碼有操作時間的限制，當使用者閒置超過 10 分鐘，便要再輸入一次密碼。在事件列表中亦會記錄在哪個時間，哪位使用者執行過什麼型式的工作（如清除、下載、登入、組態、登出等等）。

圖 4-13

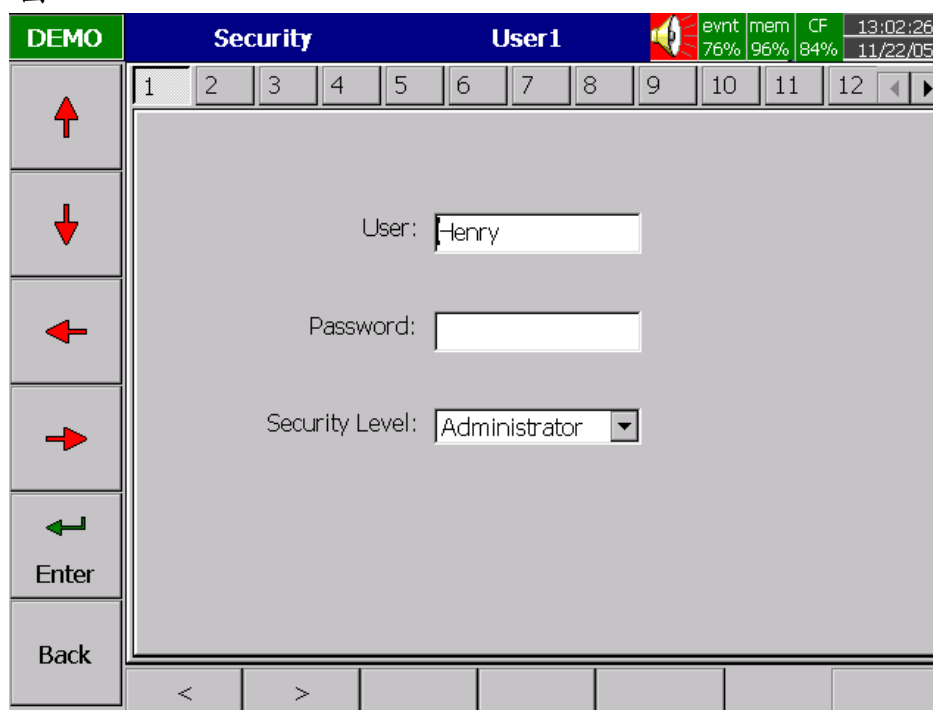

不同的安全授權

Administrator（管理者）：可設定並更改記錄器所有的組態參數功能，並有權限設定所有使用者的代號、安全階層，包括 Supervisors（監督者）與 Operators（操作員），共 30 組的使用者。

Supervisors（監督者）：可設定並更改記錄器所有的組態參數功能，但無權限設定使用者安全階層與代號。

Operators（操作員）：只能操作記錄器左側垂直接鍵，查看歷史資料、事件記錄等，但無權限操作下方按鍵之組態、下載、清除與手動操作等功能。


4.7 Demo

DEMO 模式是記錄器展示用的模擬程式，模擬 18 個類比輸入通道、12 個數學輸入通道、6 個數位輸入通道與 6 個數位輸出通道。需要啟動 DEMO 模式時，需先到組態設定畫面，然後利用記錄器左側方向鍵勾選 Demo 欄位後再將記錄器重新開機，DEMO 模式才會生效。若要終止 DEMO 模式回復正常操作時，需先將選取的 Demo 欄位消去（把打勾的符號消去），並將記錄器的關機重開即可。

4.8 系統資訊

系統資訊包括系統版本、記憶體（容量）、CF 卡（容量），Ethernet IP 位址以及插槽的插卡狀態等。

圖 4-14

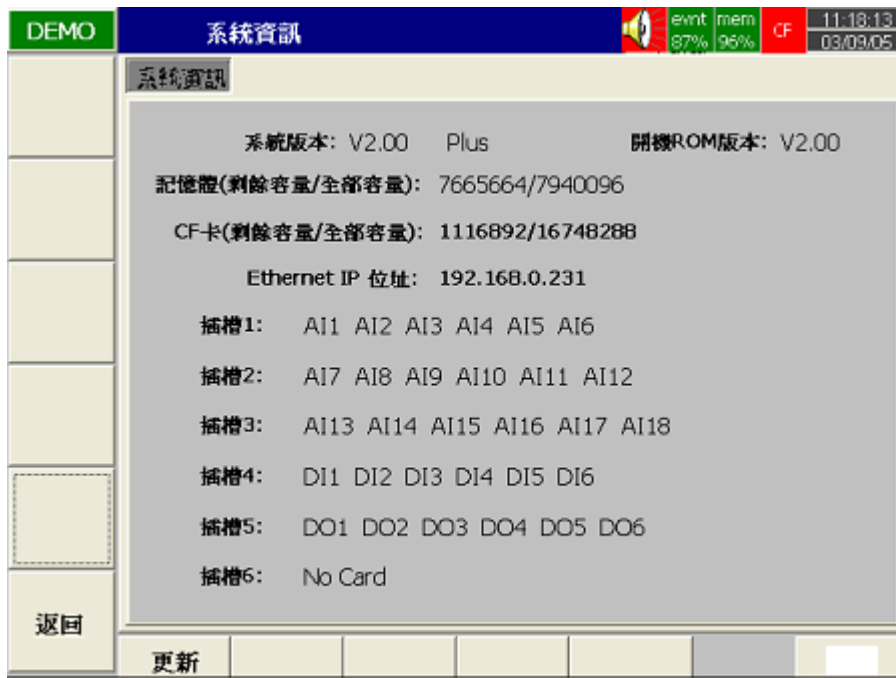

系統版本：記錄器韌體的版本。例如 V2.20—代表目前記錄器韌體為 2.20 版，若有選加選學運算功能，則 V2.20 後面會在加上“Plus”。

開機 Rom 版本：記錄器 Boot ROM 的版本。

記憶體（剩餘容量/全部容量）：記錄器內部提供 8MB 的記憶體供資料儲存使用。除了在系統資訊畫面下您可得知記憶體的可用空間與總容量的資訊外，在記錄器右上方（參考圖 4-11）的小圖示也會以百分比顯示可用空間。

CF 卡 (剩餘容量/全部容量)：顯示 CF 卡可用空間與總容量，另外，在記錄器右上方 (參考圖 4-11) 的小圖示也會以百分比顯示 CF 卡可用空間。


Ethernet IP 位址：顯示目前記錄器的 IP 位址。

插槽 1...6：顯示插槽的插卡狀態，以及所插入的 I/O 卡的種類。

更新：更新鍵位於螢幕左下方，更新時您需先將新版的程式韌體存入 CF 卡，再將 CF 卡插入記錄器，然後按下“更新”鍵即可。

4.9 組態設定範例

以下我們以一台 3 個 4-20mA 輸入通道，6 個數位通道輸出，配有 Ethernet 通訊連線執行即時監控的記錄器為例：

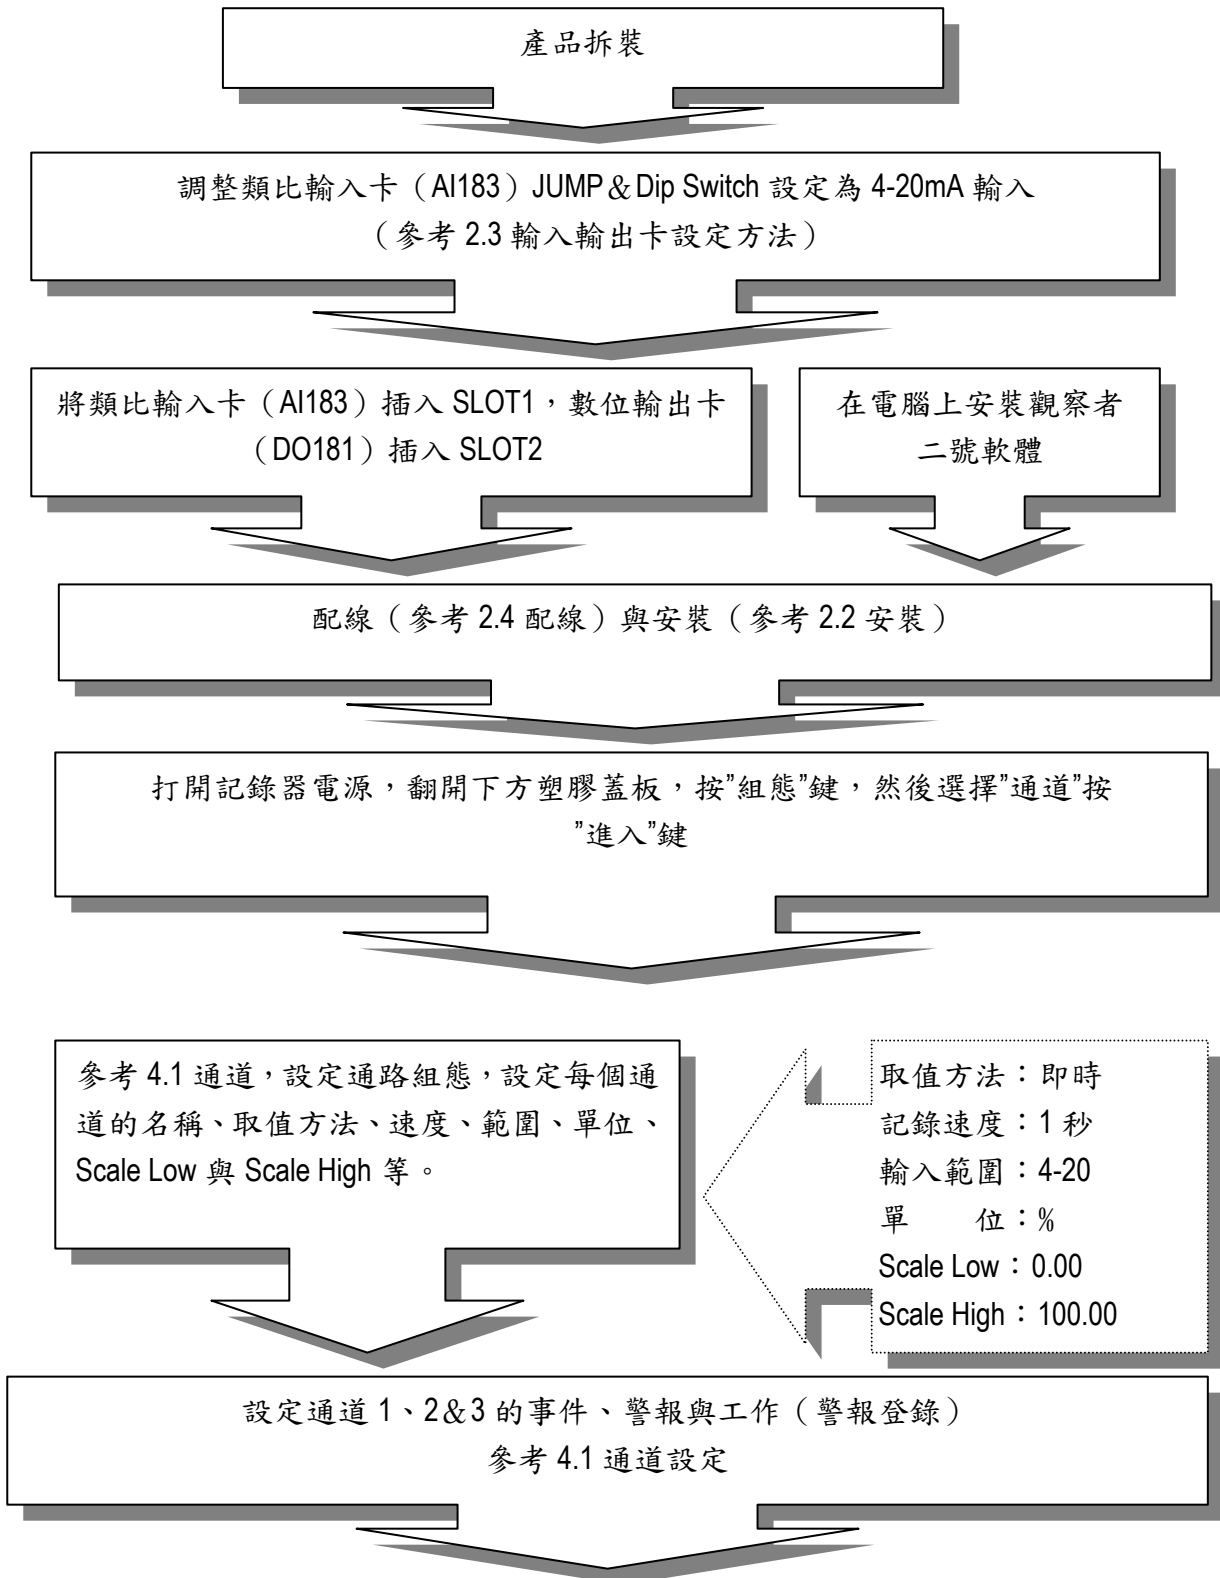

設定畫面顯示、工具、裝置、日期時間等功能（參考章節 4.2~4.5）

如果記錄器的 Ethernet 通訊不是自動由伺服器指派時，使用者必須自行定義 IP 位址與子網路遮罩（參考 4.4 裝置）。



與電腦連線（需有 Observer Π 軟體）

不與電腦連線（需有 Observer I 軟體）
使用 CF 卡（參考章節 2.5）

注意：從記錄器取出 CF 卡前，請先按“存檔”鍵，將組態資料下載入 CF 卡，再按“下載”鍵載入量測資料

5. 電腦應用軟體 — 觀察者一號 (Observer I) & 二號 (Observer II)

5.1 觀察者一號及觀察者二號電腦軟體說明

本章節為電腦應用軟體的簡易說明；詳細的軟體操作說明請參考軟體的"HELP"說明。

觀察者一號 (Observer I) & 二號 (Observer II) 是記錄器的電腦應用軟體，可抓取並分析記錄器上的量測資料，也可以做組態設定，兩者應用上的差異在於即時監控的功能，以下分別就兩者分別作說明：

觀察者一號由以下兩個程式組成：



觀察者二號由以下三個程式組成：



CONFIG_VIEWER — 可由電腦存取及設定記錄器的組態參數。

HIST_VIEWER — 可由電腦監看記錄器的歷史資料曲線。

REAL TIME_VIEWER — 可由電腦即時監看及備份(連線時) 的記錄器資料。

觀察者一號軟體隨貨附贈 (標準配備)

觀察者二號軟體提供電腦即時監看以及 logging 資料，訂貨時須另行選購。

系統需求

硬體

CPU：運算數速度 200MHz 以上。

記憶體：至少 64 MB RAM。

硬碟：可用容量 100MB 以上。

RS232 序列埠 / RJ-45 (female) 連接埠 / USB 連接埠 / CF Card Reader

作業系統

Windows 98，Windows ME，Windows 2000，Windows Xp 或 WindowsNT。

程式安裝

置入觀察者一號或二號程式安裝光碟，點擊"Setup"執行檔，依對話方塊指示步驟安裝即可。電腦上只會保留一套軟體，舉例來說：若電腦上已安裝觀察者一號程式時，若再安

裝新版的觀察者一號程式或是觀察者二號程式，則在安過程中新安裝的軟體程式會自動覆蓋原有的程式，電腦上只保留新安裝的程式。

移除觀察者軟體

若須手動移除電腦中的觀察者程式，您可以依據下列 2 種方式進行：

- 1、進入 Windows 系統的"控制台"—"新增/移除程式"—執行觀察者程式移除
- 2、滑鼠點選 Windows 系統的"開始"—"所有程式"—"Observer"—"UnInstall"

Configuration



組態參數設定程式—可以在電腦端設定好組態參數後，透過 Ethernet 或 CF 卡傳到記錄器上。

開啟組態參數設定—Windows"開始"—Observer I 或 II—Configuration

工具列



開啟（建立）新專案



開啟舊專案



儲存專案設定於電腦上



刪除電腦上的專案設定



選擇"bank"通訊庫（CF 卡/RS232/Ethernet）



選擇"通道"（AI / AO / DI / DO / MATH）組態設定畫面




選擇畫面組態設定





工具組態設定（標準-計時器 / 選配-計數器&累加器）



裝置組態設定

 查看系統資訊（插卡的類型、記錄器韌體版本等）


 日期時間設定（記錄器的時間可設定與電腦同步）

 密碼設定

 接收組態設定（從 CF 卡或透過 RS232、Ethernet 接收記錄器的組態）


 傳送組態設定（從 CF 卡或透過 RS232、Ethernet 傳送組態到記錄器）

開啟舊檔—若電腦上已有之前便設定好的組態專案，只要用滑鼠點選欲開啟的檔案” * *.prj”，開啟即可。

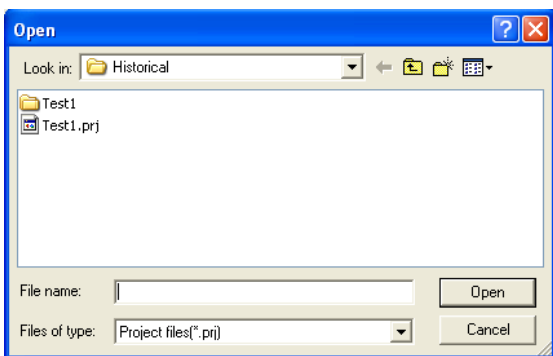


開啟（建立）新檔—若欲開啟新專案，可用滑鼠點選上圖的”Cancel”（取消），然後點選

左上方的 ，便會自動跳出建立新專案檔名的欄位（如下圖）

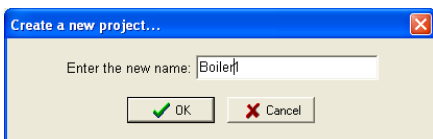


在空白欄位鍵入新的專案名稱按”OK”（確認）後，螢幕會自動跳出通訊庫設定畫面

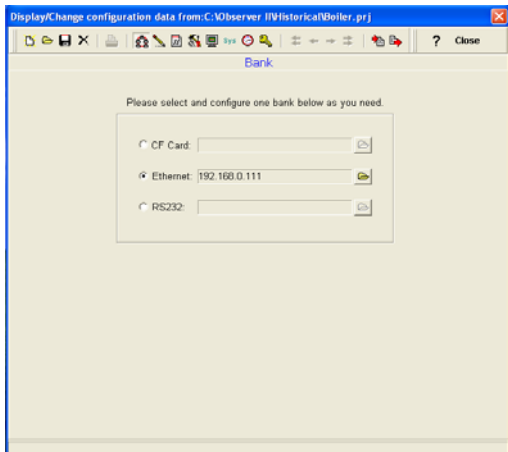

通訊庫是用來選擇記錄器與電腦組態傳送路徑：

記錄器的組態可經由以下三種路徑傳送到電腦

- ⊙ CF card—透過 CF 卡
- ⊙ Ethernet—經由乙太網路傳送
- ⊙ RS232—透過 RS232/422/485 三合一介面傳送

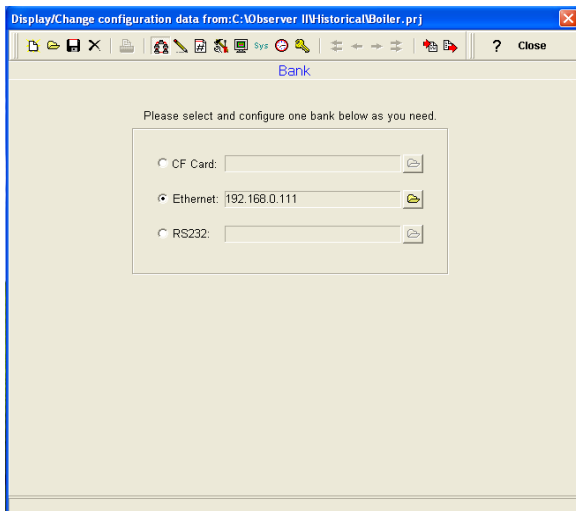

(CF 卡隨貨附贈 1pc，Ethernet 為標準配備，RS232/422/485 三合一通訊介面則需選購才有此功能)

5.2 Ethernet 通訊設定

觀察者二號軟體可透過標準 Ethernet 網路一次連接多台記錄器並同步將量測資料儲存至電腦。使用觀察者二號軟體，最多可連接 255 台記錄器—1024 筆通道 (AI / Math / DO / DI / 累加器 / 計數器總通道數)。

Ethernet 通訊設定步驟如下：

1、請先確認電腦上的網路參數可開放設定（IP 位址、子網路遮罩、預設閘道等參數，若無開放請洽系統網管人員）。

2、在電腦上安裝觀察者二號軟體，將觀察者二號軟體光碟放入光碟機，點選”Setup.exe”執行檔，依指示步驟安裝即可。


3、設定記錄器上的 Ethernet 參數


- 請參考本操作手冊 **4.4 裝置** 進入 IP 位址、子網路遮罩與預設閘道等欄位，在記錄器上手動設定。
- 預設閘道—若記錄器所安裝的網路內有子網域的架構（同一個內部網路切割若干不同的子網域），則記錄器內的預設閘道設定須與記錄器所在的子網域預設閘道一致。
- 子網路遮罩—用來判斷 PC 與記錄器是否於同一個區域網路內（兩者設定須一致）。
- 一般於區域網路，系統管理人員會設定子網路遮罩與預設閘道，請詢問該系統管理人員取得與記錄器連接的區域網路之預設閘道及子網路遮罩位址，再利用記錄器的按鍵在”裝置”內輸入這些位址。
- 記錄器內的預設閘道之出廠設定為：0.0.0.0。
- 設定 IP—設定記錄器的 IP 須由使用者手動進入記錄器的”裝置”組態畫面下設定。IP 位址須選該區域網路系統的管理人員確認，已取得可用（該區域網路的合法 IP）且不與其他裝置重複的有效 IP 位址。

4、連接路網路線。網路的连接建議使用 UTP（無遮蔽雙絞線）Cat.5 纜線（即一般的網路線），網路線最大的傳輸距離（從記錄器到 PC/LAN/HUB）為 100 公尺，若傳輸距離超過 100 公尺，請於每 100 公尺處增加區域網路的訊號增強的配件。

5、確認記錄器連接的型式：

- a.直接（單機）與電腦連接，需使用網路跳線（Crossover）
- b.與集線器（HUB）連接，使用標準 Cat.5 網路線。

標準 Cat.5 網路線 VR18-LAN/HUB			網路跳線 VR18-PC/Notebook	
RJ-45 PIN	RJ-45 PIN		RJ-45 PIN	RJ-45 PIN
1 Tx+	1 Rc+		1 Rx+	3 Tx+
2 Tx-	2 Rc-		2 Rc-	6 Tx-
3 Rc+	3 Tx+		3 Tx+	1 Rc+
6 Rc-	6 Tx-		6 Tx-	2 Rc-

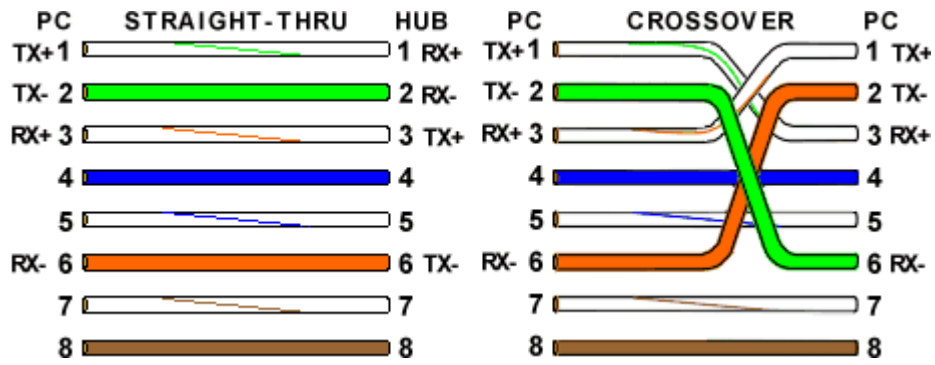

6、選用適當的網路線配接，並觀察下列項目確認網路線連接是否正常：

記錄器端—網路線連接處上方的 LED 指示燈

LINK (綠光 LED)

綠光 LED 亮：記錄器與 PC/HUB 之間的網路線連接正常。

綠光 LED 不亮：記錄器與 PC/HUB 之間的網路線連接異常或無連接。

TX/RX


橘光 LED 亮 (持續亮)：無連線狀態。

橘光 LED 閃爍：連線通訊狀態。


7、確認記錄器之網路線連接正常後，便可啟動電腦上的觀察者二號軟體 (請參考下列路徑)：

- 電腦”桌面”—”開始”—”所有程式”—”Observer II”—”Configuration”


※若是第一次使用觀察者軟體，在歷史資料的舊檔案內將無任何已存檔的”***.prj”。

- 開啟新檔 。

- 輸入新的專案名稱，例如：(P.54) Boiler。

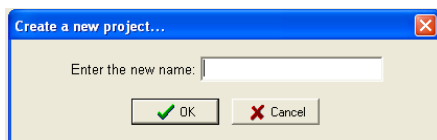


- 在通訊庫中點選 Ethernet。

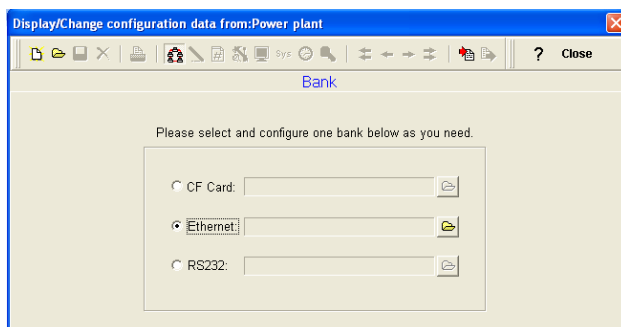

- 點進去 Ethernet 後方的  。


- 輸入記錄器的 IP 位址。

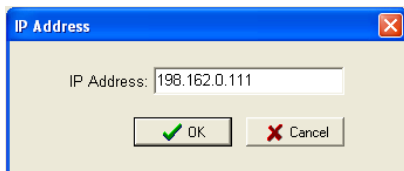


- 系統會出現一個對話方塊：“現在要接收組態資料嗎? (Y/N)”。

- 按“Yes”便可將記錄器上的組態資料載入電腦。

- 組態資料成功載入後，電腦會出現“組態資料接收成功”，此時，您可以開始在電腦上設定記錄器的組態參數。所接收的組態上包含所有輸入、輸出或數學通道的資訊，以及 AI 設定的訊號型式等等。

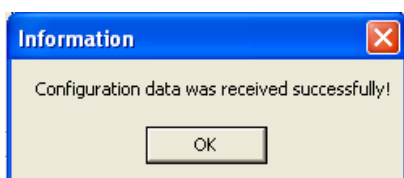

- 若組態下載失敗，電腦上會出現“記錄器沒有反應，連線失敗！”

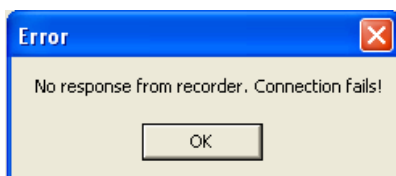




- 組態下載失敗時，請檢查（確認）網路線及記錄器與集線器/電腦端是否連接妥當，並觀察記錄器上的 RJ45 接頭（網路線連接處）上的 LED 是否顯示正常。

- 若網路線連線正常，請進入記錄器內的“裝置”設定，確認 IP 位址、子網路遮罩及預設閘道是否正確，並確認 IP 位址是否為可用，且無與區域網路內的 IP 位址衝突（即記錄器不與電腦或其他區域網路內的裝置之 IP 重複）。


5.3 RS232，RS485，RS422 設定

觀察者二號軟體可透過 RS485 連線，一次連接多台記錄器並同步將量測資料儲存至電腦。使用觀察者二號軟體，最多可連接 247 台記錄器－1024 筆通道（AI / Math / DO / DI / 累加器 / 計數器總通道數）。


- 1、確認記錄器有選配 RS232 連接埠（三合一通訊介面，記錄器為 DB9M Port）。
- 2、確認欲連線的電腦有 RS232 連接埠（無 232 連接埠的話可就近至電腦材料行購買 USB 轉 232 轉接線）。
- 3、請參考章節 **2.5 RS232/RS485/RS422 配線說明** 連接電腦至記錄器的 RS232 纜線。
- 4、參考章節 **4.4 裝置** 在記錄器上設定 RS232 通訊之組態參數－包括位址（即節位點）、傳輸速率（即每秒傳輸位元）、資料格式（同位檢查,資料位元,停止位元）。設定完成後，按“返回”鍵儲存設定值，並將記錄器關機重開後，新的 RS232 通訊參數才會生效。
- 5、進入電腦“Observer II”程式的“Configuration”－開新檔案－進入通訊庫設定－選擇 。
- 6、點擊 RS232 後方的 ，進入電腦端的 RS232 通訊庫設定。

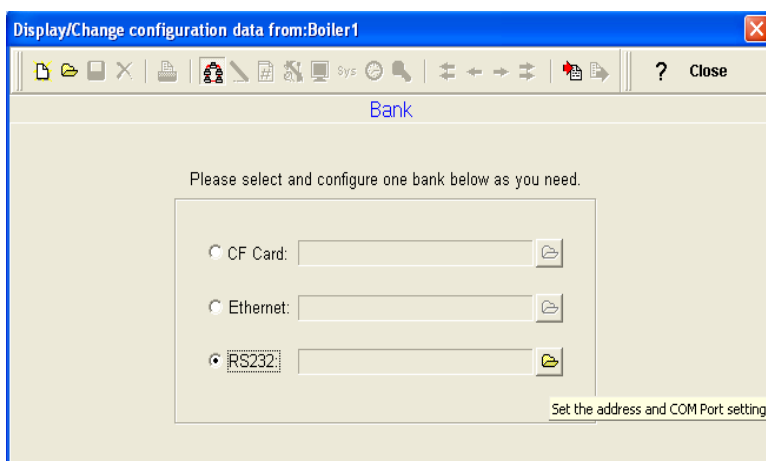

- 7、設定電腦端的 RS232 通訊庫（如下）：

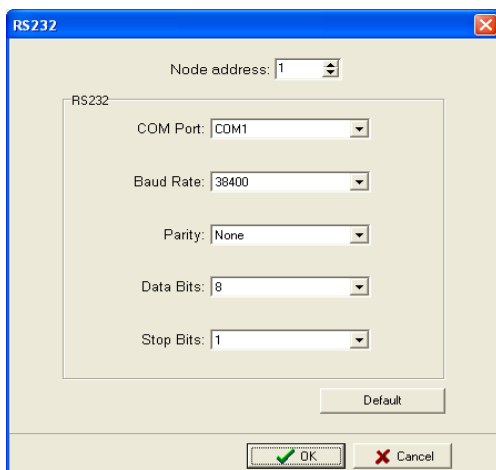


8、Node address (節點位) 的出廠預設值為"1"若節點位 (即記錄器上的位址) 與其他裝置衝突有需要更改時，請記得需要在記錄器上手動更改欲設定的新位址，並在電腦端的節點位上輸入記錄器的新位址。設定完成後，點擊"OK (確定)"，電腦便會出現下方對話方塊 (現在要接收組態資料嗎?Y/N)：

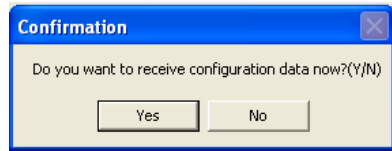


9、按"Yes (確定)"，將記錄器組態傳送到電腦上。

10、組態載入成功後，電腦上會出現"組態資料下載成功！"，此時，您可以開始在電腦上設定記錄器的組態參數。所接收的組態上包含所有輸入、輸出或數學通道的資訊，以及 AI 設定的訊號型式等等。

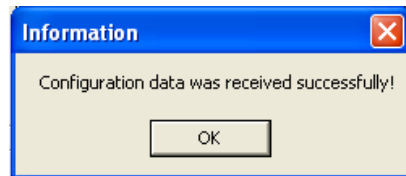

11、若組態下載失敗，電腦上會出現"記錄器沒有反應，連線失敗！"

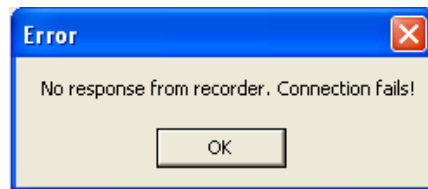


12、組態下載失敗時，請檢查 (確認) 記錄器與電腦端的 RS232 纜線是否連接妥當，並再次檢查記錄器與電腦上的觀察者二號內關於連線的 RS232 之位址、傳輸速率、同位檢查位元、資料位元、停止位元等參數設定是否一致。

13、若是多台記錄器透過 RS485/422 連線，請確認 RS485 網路上每壹台裝置的位址無重複設定 (檢查每台記錄器之通訊參數設定)。

14 多台記錄器連線時需透過 SNA-10A (RS485 轉 232 轉接器)，串接 SNA-10A 時請確認 SNA-10A 的通訊組態設定正確 (以 SNA-10A 上 Dip Switches 調整)。

15、確認傳輸距離：最遠一台記錄器與電腦之距離不得超過 1000 公尺，且確認以適當線材串接 (可以線徑適當之一般傳輸導線串接，並視現場環境加強防干擾披覆)。

16、運用 RS232/485/422 與電腦連線時需使用電腦的连接埠，在連線前請先確認電腦是否可以提供可用的连接埠。若須確認電腦连接埠的狀況，可以點選電腦桌面上的"我的電腦"—"控制台"—"系統"—"硬體"—"裝置管理員"—"連接埠"—"通訊連接埠"然後按滑鼠右鍵，點"內容"便可進入"通訊連接埠內容"。如下圖：

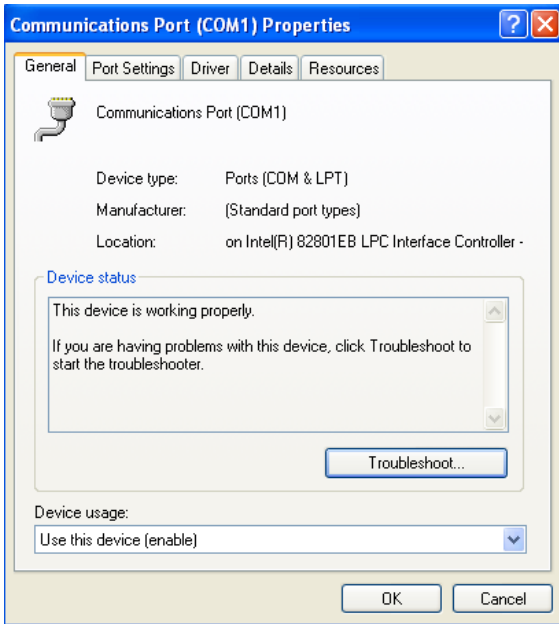


裝置使用方式 (Device usage)：使用這個裝置 (啟用)。

裝置狀態 (Device status)：這個裝置已正確地運作。

17、若裝置使用方式與裝置狀態沒有啟用或是正確地運作，則電腦的 RS232 連接埠會無法使用，請連絡系統管理人員協助您變更連接埠或是重灌連接埠的驅動程式。
(確認並執行上述步驟後，若還無法連線，建議您另外找一台有可用連接埠的電腦安裝觀察者軟體，執行連線設定。)

18、確認電腦上連接埠的傳輸速率 (即每秒傳輸位元)、資料格式 (同位檢查, 資料位元, 停止位元) 與記錄器上的設定相同。

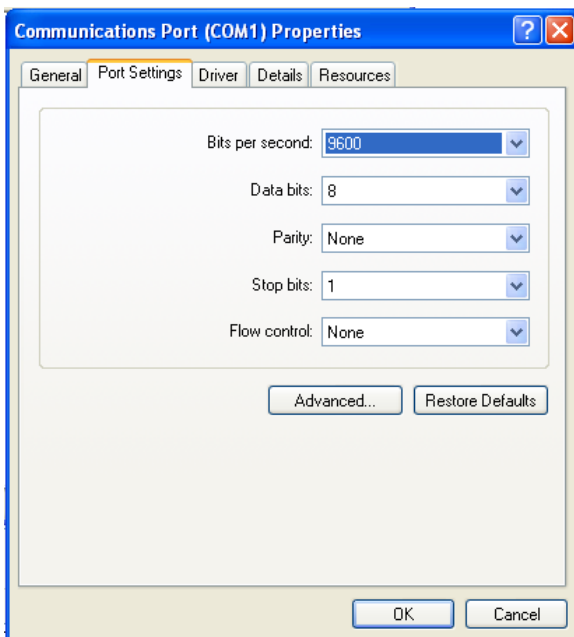

5.4 使用 CF 卡讀取組態

1、記錄器隨機附一張 CF 卡，在不使用網路連線的情況下，您可以用 CF 卡來傳輸組態資料。

2、下載記錄器組態至 CF 卡步驟如下：

按”組態”進入組態設定畫面—插入可用的 CF 卡—按”存檔”


此步驟可以確認並儲存記錄器輸入/輸出卡的資訊及每個通道的訊號輸入型式

3、在電腦上安裝 CF 讀卡機（一般都是使用 USB 連接埠），插入 CF 卡，執行觀察者程式讀取 CF 卡組態資料。


請注意：市面上主要的 CF 卡讀卡機都可以在 Windows Xp 下被自動偵測並驅動，若您使用的作業系統是 Windows 98 / 2000 / ME / NT 等，則需再電腦偵測到 CF 讀卡機（大量存取裝置）時，手動安裝讀卡機的驅動程式。

4、當電腦偵測到裝著 CF 卡的讀卡機時，在”我的電腦”下會出現一台”卸除式磁碟”即為 CF 卡讀卡機。


5、執行觀察者程式：”開始”—”所有程式”—”Observer I 或 II”—”Configuration”


開新檔案 。


輸入新的專案名稱，例如：(P.54) Boiler。

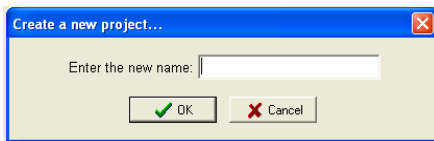


6、點選 CF 卡。

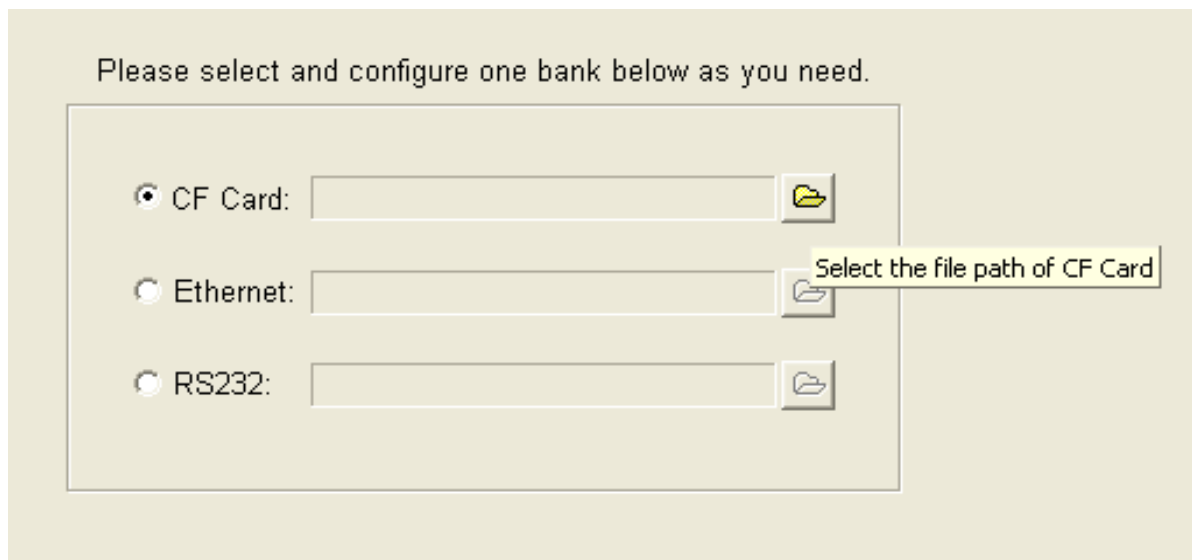


7、點擊  選擇讀取讀卡機的路徑。

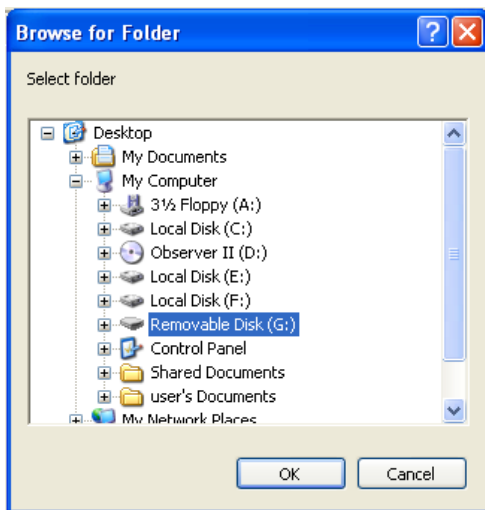

8、按“OK（確定）”，電腦會跳出一個對話方塊（現在要接收組態資料嗎？Y/N），按“Yes（確定）”便可開始接收 CF 卡上的組態。

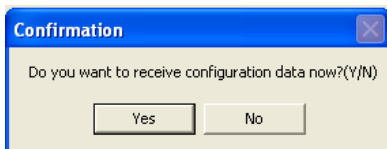


9、組態資料成功載入電腦後，畫面上會出現，電腦上會出現“組態資料下載成功！”，此時，您可以開始在電腦上設定記錄器的組態參數。所接收的組態上包含所有輸入、輸出或數學通道的資訊，以及 AI 設定的訊號型式等等。

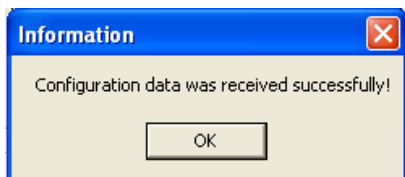

10、若組態下載失敗，畫面上會出現“找不到組態資料檔！”的對話方塊，這表示讀取 CF 卡的程序出了問題，原因可能是：

a、CF 沒有組態資料—可用“檔案管理員”檢查 CF 卡內是否有組態資料的檔案，正確下載的組態資料應包含“IO（dat 檔案）”以及“Recorder.cfg”兩個檔案，有漏缺檔案代表沒有正確執行下載的動作，請再執行一次上述步驟 2~9。

b、選擇錯誤的 CF 讀卡機存取路徑—重新執行一遍上述步驟 5~9。

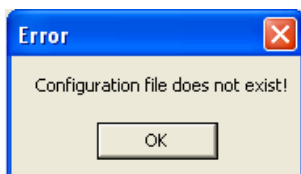

5.5 在 Real-Time Viewer 下設定組態



組態資料

在 Real-Time Viewer 下設定的組態為電腦上即時連線時的組態，其組態設定為獨立，可以與記錄器上的組態不同。

Tag Name	Bank	Node/IP	Tag Type	Device Type	Addr...	EngHi	EngLo	Unit	Deci...	Alarm1	SP1
AI1	1	192.168.0.111	VR18	Channel1		4553.6	-199...	°C	1	Hi	24.0
AI2	1	192.168.0.111	VR18	Channel2		4553.6	-199...	°C	1	No	
AI3	1	192.168.0.111	VR18	Channel3		4553.6	-199...	°C	1	No	
DI1	1	192.168.0.111	VR18	DI1		65535	0		0	No	
DI2	1	192.168.0.111	VR18	DI2		65535	0		0	No	
DI3	1	192.168.0.111	VR18	DI3		65535	0		0	No	
DI4	1	192.168.0.111	VR18	DI4		65535	0		0	No	
DI5	1	192.168.0.111	VR18	DI5		65535	0		0	No	
DI6	1	192.168.0.111	VR18	DI6		65535	0		0	No	
DO1	1	192.168.0.111	VR18	DO1		65535	0		0	No	
DO2	1	192.168.0.111	VR18	DO2		65535	0		0	No	
DO3	1	192.168.0.111	VR18	DO3		65535	0		0	No	
DO4	1	192.168.0.111	VR18	DO4		65535	0		0	No	
DO5	1	192.168.0.111	VR18	DO5		65535	0		0	No	
DO6	1	192.168.0.111	VR18	DO6		65535	0		0	No	
Cont1	1	192.168.0.111	VR18	Counter1		65535	0		0	No	
Cont2	1	192.168.0.111	VR18	Counter2		65535	0		0	No	
Cont3	1	192.168.0.111	VR18	Counter3		65535	0		0	No	
Cont4	1	192.168.0.111	VR18	Counter4		65535	0		0	No	
Cont5	1	192.168.0.111	VR18	Counter5		65535	0		0	No	
Cont6	1	192.168.0.111	VR18	Counter6		65535	0		0	No	
Tolz1	1	192.168.0.111	VR18	Totalizer1		4294...	0.0		1	No	
Tolz2	1	192.168.0.111	VR18	Totalizer2		4294...	0.0		1	No	
Tolz3	1	192.168.0.111	VR18	Totalizer3		4294...	0.0		1	No	
Tolz4	1	192.168.0.111	VR18	Totalizer4		4294...	0.0		1	No	
Tolz5	1	192.168.0.111	VR18	Totalizer5		4294...	0.0		1	No	
Tolz6	1	192.168.0.111	VR18	Totalizer6		4294...	0.0		1	No	

點擊試算表中 Tag 名稱（通道）兩次，可以修改 Tag（通道）的郵件傳送的功能參數，如下圖（僅工作項目可以修改，其餘欄位內淺灰色的文字則無法修改）。工作欄位內可選擇 a、無動作；b、傳送郵件—若在記錄器的通道組態有設定事件型式（Type）與設定值（Setpoint），然後在這裡選擇“傳送郵件”（還需設定郵件 pop，詳 P.65），Real-Time Viewer 便會在警報事件發生時傳送警報郵件至使用者所指定的信箱。

Modify tag data

Auto-update

Tag Type: DEMO Tag Name: AI1

Bank: 1 Device Type: Channel1

Protocol: Modbus_TCP LogSpeed: 1 S

IP Address: 192.168.0.111 LogMethod: Instant

Alarm Type	Setpoint	Job
1 Hi	24.0	Send Email
2 HIHI	26.0	Send Email
3 No		No Action
4 No		No Action

Engineering

High: 4553.6 Unit: °C

Low: -1999.9 Decimal: 1

OK Cancel

選擇上述的傳送郵件功能，所發送的警報郵件格式如下列範例：

Type : HiAlarm

Source : AI1

ActiveTime : 12/12/20059 : 49 : 59AM

Value : 23.8




選項

選項參數下有**共用**、**電子郵件**、**通訊**（Ethernet 的通訊取值速度）三個項目可以設定。

共用：有「開放資料共用，讓別人也能讀取」、「資料不共用」兩個選項；選擇「**開放資料共用讓別人也能讀取**」選項時，主要連接記錄器的電腦會開放即時連線的資料檔（C:\Observer），透過區域網路，其他電腦可以讀取這台電腦的連線歷史資料（可手動更新資料）。

舉例來說：當一台主電腦正與記錄器連線，而你需要從廠區或辦公室的其他電腦對連線的資料做分析時：

- 1、將主電腦 Real-Time Viewer 依上述說明選擇「開放資料共用，讓別人也能讀取」。
- 2、在分析資料的電腦上安裝觀察者二號軟體。
- 3、軟體安裝完成後，進入"Observer II"，出現開啟舊檔（如下）畫面時，不要點選欄位內的檔案，用滑鼠點選"移到上一層（紅箭號所指）"，直到移到"桌面"—"網路上的芳鄰"—點入"連接記錄器的主電腦"—點入"C 磁碟機"—點入"Observer II"—點入"Real-time"檔案夾—點選"正在即時連線的檔名.prj"即可，若需要載入最新的量測資料，可以手動執行"輸入量測資料"。

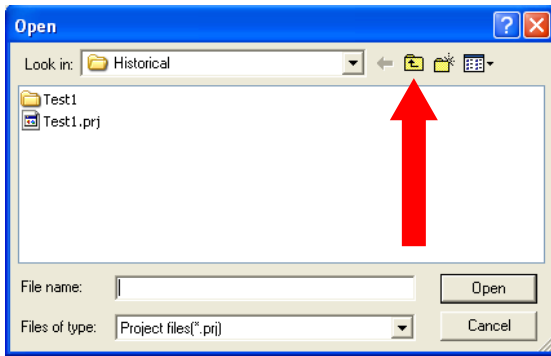


電子郵件：觀察者軟體內 STMP server 預設的 Port 值為 25，若您的區域網路設定傳送 Internet/email 的 Port 有不同的設定，請依照電腦接網路的 STMP port 參數修改。

設定自動傳送警報郵件設定方式如下：

設定 SMTP server 相關組態，請洽詢系統管理人員，確認在該區域網路的相關設定：
如

Host，Port (25)，使用者名稱，從：(輸入發信位址)，到：(輸入電子郵件寄達位址，最多可以輸入十個收件人信箱)。

通訊：可以設定即時連線時的取樣時間 (區間)，進行即時連線監控時，使用者可選擇下列的取樣時間：




舉例來說：如果記錄器與電腦透過 Ethernet 進行遠距的即時連線且須經由不同的閘道及路由器時，使用者可以在"通訊"選用適當的取值時間區間。由於遠端網路存取會造成資料交換的時間延遲，所以再透過乙太網路時適當放大取值時間，可確保連線的穩定品質，例如設定"60 S"則電腦與記錄器會在 60 秒時進行一次資料交換。



通訊庫：用來修改在執行即時連線時，記錄器與電腦的通訊通道。通訊庫內可設定四組通訊通道 (Bank 1 ~Bank 4)，每組通訊通道可個別設定不同的通訊協定：包括"關閉"、"Modbus_TCP"、"Modbus_RS232"三種設定。這裡的通訊庫專供即時連線時的通訊通道，與 P.55 的通訊庫 (存取路徑) 不同。

在觀察者二號的 Ethernet 通訊埠號已指定為"502"，若自行改變設定便無法建立觀察者軟體與記錄器之間的即時連線。埠號：502 用來建立觀察者軟體與記錄器之間的通訊，以轉介 Ethernet 與 Modbus_TCP 通訊協定的資料。

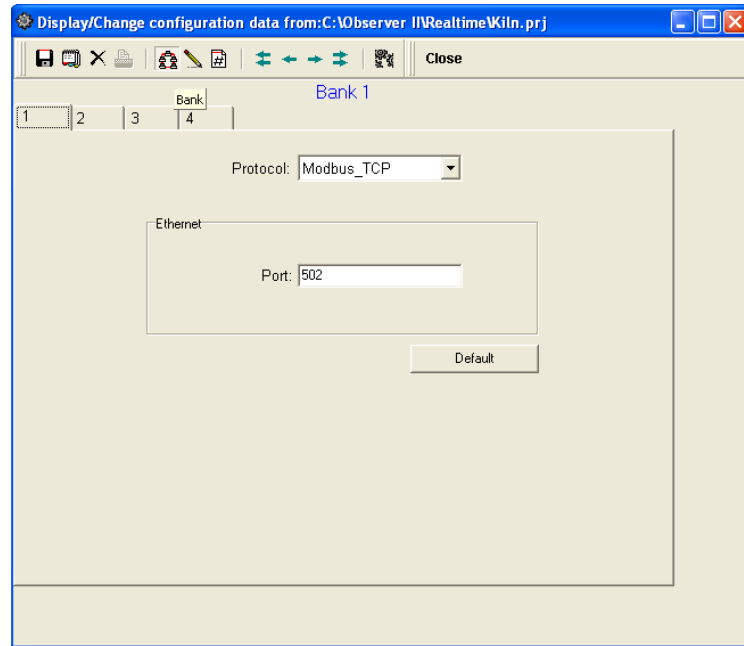

5.6 DDE 動態資料交換


DDE 連結

DDE (Dynamic Data Exchange) 是一種標準的 Microsoft Windows 通訊協定，它定義了 Windows 應用程式共用資訊的一種機制，支援 Windows 作業系統的應用程式之間資料交換功能。


執行 DDE 連結可同步擷取觀察者二號的即時連線資料到 Excel 檔。

請注意！您無法直接從記錄器上擷取資料到 Excel，而是在記錄器與觀察者軟體正確地連線後，透過 DDE 連結將觀察者二號的即時數據資料抓到 Excel 內。

執行方式：先將建立觀察者二號的即時監看 (Rela-Time Viewer) 與記錄器連線一點入左上方"專案 (Z)"拉下選單一點選"建立 DDE 連結於 Excel 檔 (D)"="Creat DDE link in Excel"

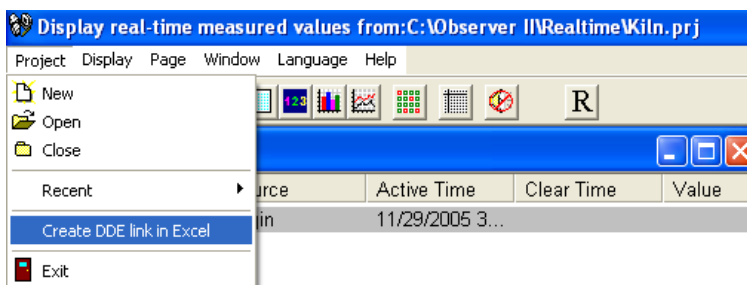


設定 DDE Excel 檔的名稱及存取路徑：如下圖

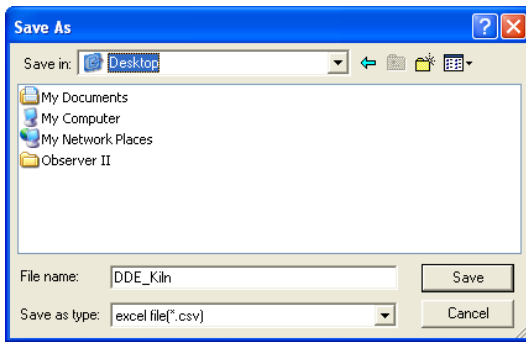

預設檔名為“DDE_專案名稱”(加底線是為了避免專案名稱與 DDE 連在一起容易搞混)，預設之存取位置在“C 磁碟機”，或是依照上圖存放位置 (Desktop) 儲存後，可以在桌面上找到該 DDE_Excel 檔。

如果您的電腦上沒有安裝**微軟 Office** 應用程式，便無法開啟所儲存的 DDE Excel 檔案。請聯絡貴公司系統管理人員協助安裝**微軟 Office** (也可就近至**微軟經銷商**購買 Office 軟體自行安裝)。

確認您系統已有 Office 應用程式後，您可以試著開啟桌面上的 DDE (觀察者軟替需連上記錄器)。

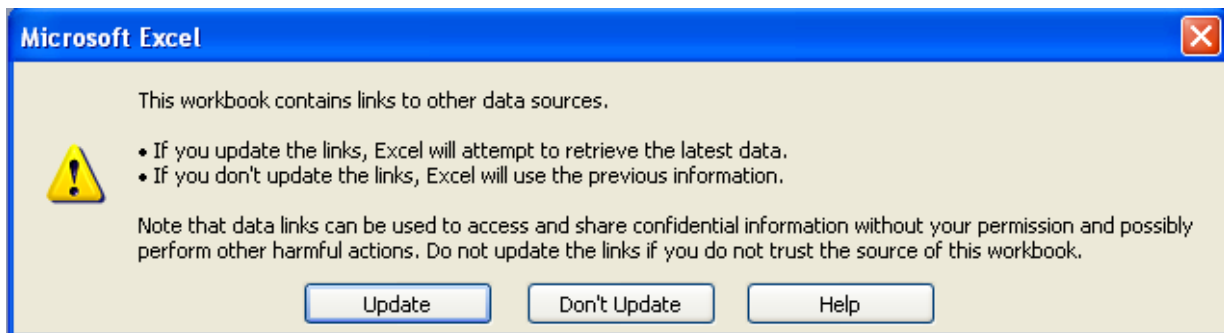


點擊“Update (連結)”啟動觀察者軟體與 Excel 的 DDE 連結。DDE 連結成功時，Excel 會以簡單的格式列所有通道名稱、單位、數值 (即時更新)。

擷取觀察者即時資料之 DDE 語言格式範例如下：

```
=RealTime_Viewer | TagServer!_A11  
  
Application=RealTime_Viewer  
Topic=TagService  
Tag name=A11
```

請注意！在”！”字元後須先加底線”_”再接 tag name。

其他 Windows 系統下的應用軟體亦有機會透過 DDE 擷取觀察者程式的 AI/DI/DO/計次器與累加器等通道資料。

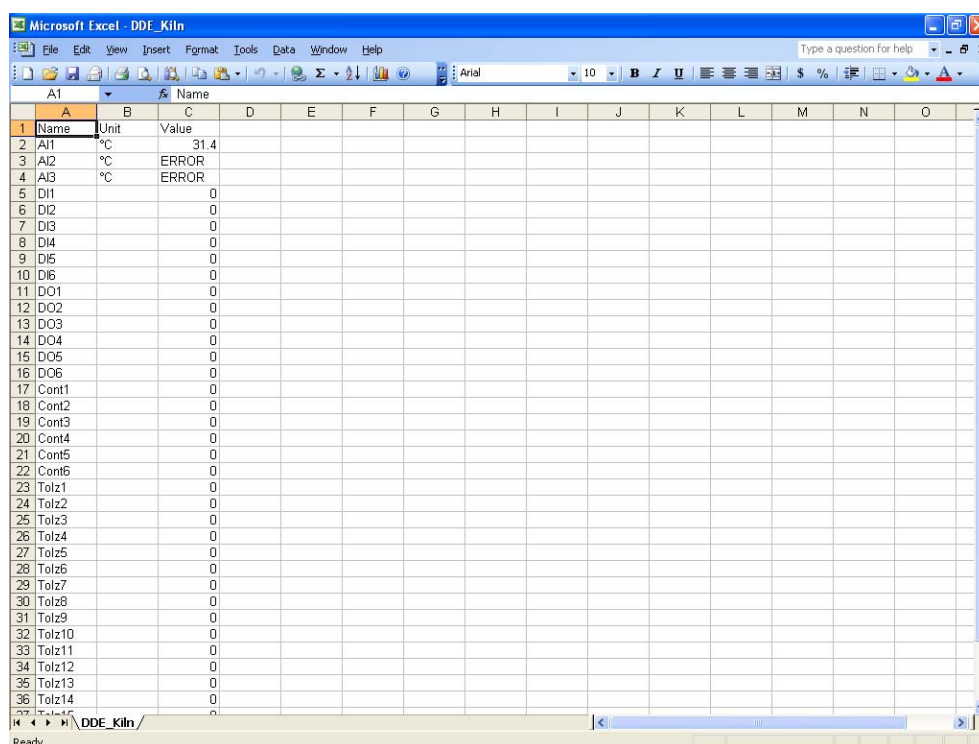

Name	Unit	Value
AI1	°C	31.4
AI2	°C	ERROR
AI3	°C	ERROR
DI1		0
DI2		0
DI3		0
DI4		0
DI5		0
DI6		0
DO1		0
DO2		0
DO3		0
DO4		0
DO5		0
DO6		0
Cont1		0
Cont2		0
Cont3		0
Cont4		0
Cont5		0
Cont6		0
Tolz1		0
Tolz2		0
Tolz3		0
Tolz4		0
Tolz5		0
Tolz6		0
Tolz7		0
Tolz8		0
Tolz9		0
Tolz10		0
Tolz11		0
Tolz12		0
Tolz13		0
Tolz14		0

若 Excel 數值儲存格內出現”ERROR”可能是因為你所選的通道沒有正常的資料傳入，請檢查異常的 tag 在記錄器的訊號是否正常，以及觀察者軟線設定是否正常。

如果”名稱 (NAME)”欄位出現”NAME”而非”AI1...Tolz2...DO2..DI1..Cont4..”等名稱，代表出現”NAME”的通道沒有被正確的設定。可能是該通道在觀察者軟體中為無效的通道名稱設定，若發生此種狀況，請依下列連結確認觀察者軟體中有效的通道名稱：

進入”顯示即時量測值” (RealTime viewer) 畫面—”顯示 (Y)”—”組態資料 (Y)”

注意：若 Excel 無法從儲存的位置開啟，請依照下列項目檢查、確認

- 1、電腦的 RAM 容量過小—電腦重開機，重新建立 DDE Excel 檔案，然後再開啟。
- 2、增加電腦虛擬記憶體—請聯絡系統管理人員，依下列步驟檢查電腦虛擬記憶體的設定：
我的電腦—控制台—系統—進階—效能選項—進階—虛擬記憶體—變更

DDE 的其他應用

只要觀察者的連線資料透過 DDE 連結匯入 Excel 的儲存格內，就可以提供給其他的應用程式；如 PLC、SCADA 或是 Visual Basic 等。

若要應用 PLC 讀取量測資料，可請設定 PLC 的程式人員，在 DDE 連結的 Excel 檔案內點選“工具 (T)”-“巨集 (M)”，編寫巨集：

若須參照程式碼範例；PLC 程式編寫人員可以參考 PLC 的使用手冊內的 DDE 巨集範例。在 SCADA 系統應用上，亦可以透過 DDE 連結把記錄器傳送到觀察者軟體的資料擷取到 SCADA 系統。

範例一：DDE 連結—使用 Allen-Bradley SLC 5/03 PLC 擷取 Excel 的資料

Task：Write a block of data (10 floating points) from to PLC

Name of the Excel file=Reports.XLS

Data Source：D37 to D 46，data in total 10 cells

Target=PLC，Starting address =F8

User RSLinx to configure PLC and DDE link

DDE topic name in RSLinx=DDE REPORTS

Sub Block_Write()

```
'open dde link: testsol=DDE Topic This is comment only
```

```
RSIchan = DDEInitiate("RSLinx", "DDE_REPORTS")
```

```
'write data thru channel This is comment only
```

```
DDEPoke RSIchan, "F8:2,L10", Range("[Reports.XLS]PROCESS!D37:D46")
```

```
'close dde link This is comment only
```

```
DDETerminate (RSIchan)
```

```
End Sub
```

範例二：DDE 連結－將 Allen-Bradley SLC 5/03 PLC 寫入 Excel 檔案

Task: Read a block of data (5 integers) from PLC to Excel

Name of the Excel file = Reports.XLS

Data Source: PLC, Starting address= N7:30

Target cells in Excel= A7 to A11

User RSLinx to configure PLC and DDE link

DDE topic name in RSLinx= DDE_REPORTS

Sub Block_Read()

'open dde link: testsol=DDE Topic This is comment only

RSIchan = DDEInitiate("RSLinx", "DDE_REPORTS")

'get data and store in data variable This is comment only

data = DDERequest(RSIchan, "N7:30,L5,C1")

'Paste data into selected range This is comment only

Range("[Reports.XLS]DDE_Sheet!A7:A11").Value = data

'close dde link This is comment only

DDETerminate (RSIchan)

End Sub

範例三：觀察者軟體與 SCADA (Allen-Bradley RSVIEW 32) 的 DDE 連結

當觀察者二號 (Real Time) 與記錄器連線正常時，可以下列程式格式抓取觀察者軟體的通道資料 (tag data)：

=RealTime_Viewer|TagService!_AI1

Application = RealTime_Viewer

Topic = TagService

Tag name = _AI1 (Please observe underscore before the name of the tag)

上述程式可以直接在 SCADA 內設定，以啟動觀察者軟體與 RSVIEW32 SCADA 的 DDE 連結。無須在 RSLinx 作任何設定。

設定程序

- 1) 開啟 SCADA 專案
- 2) System—Node—select DDE server as data source
- 3) Name=VR18 (VR18 字間不能有空格)
- 4) Application=RealTime_Viewer
- 5) Topic=TagServer
- 6) Check enable in the box. (選擇 DDE server 資料來源的 source)
- 7) 開啟資料庫
- 8) 設定類比通道(tag)—請設定與記錄器上組態相同的名稱等。
- 9) Select VR18 at the NODE
- 10) 寫入 tag “位址”，這裡所稱位址通常是指與觀察者軟體及記錄器上相同的預設通道名稱；例如：第一點類比輸入通道名稱—AI1，則位址應寫入“_AI1”（注意：_AI 前一定要加上底線“_”，否則資料無法交換）
- 11) 開啟上述 tag (通道)監看與組態畫面，並檢查 DDE 上的通道資料。

DDE 設定正確後，通道數值會顯示正確的數值以及“Valid”（有效的）的狀態，若是出現錯誤請從新執行步驟 1)。在執行前請先確認電腦上的即時連線，Tag monitor 已開啟並執行中。

6. 應用範例

範例 1：流量記錄

請參考以下程式換算不同的單位

Q (以 公升 / 分鐘為計算流量的單位) = 0.0072 * h * 60

h (以 mbar / 每秒為計算流量的單位) = 0~30 mbar

參考章節 4.1 通道的組態設定模式，依下列方式方式設定 AI1：

名稱：Level 1	說明：XXXXXXXX
登錄方法：即時	速度：1 S (每秒紀錄一點)
偏移值：0.00	倍增值：1.000
感測器：Current	單位：mA Range：4.0~20.0
Scale	單位：mbar Low：0.00 High：30.00

按“數學”(下排)鍵，進入數學數學通道設定模式，依下列參數設定 Math1

名稱：Level 1	說明：XXXXXXXX	
型式：啟動	登錄方法：即時	速度：1 S (每秒紀錄一點)
數學運算式：0.0072 * AI1 ^ 2.5 * 60		
單位：1 /min	Low：0.0	High：2200.0

範例 2：設定每週一~週五，早上 8：00 開始記錄，下午 17：00 停止記錄

選擇組態內的“工具”設定模式，依下列方式設定計時器一~計時器四

計時器一	計時器二		
型式：每日	作用：啟動	型式：每日	作用：啟動
時間：8 小時 0 分鐘		時間：17 小時 0 分鐘	
工作一：儲存啟動		工作一：儲存暫停	

計時器三

型式：每週 作用：啟動

時間：星期六 8 小時 1 分鐘

工作一：儲存暫停

計時器四

型式：每週 作用：啟動

時間：星期日 8 小時 0 分鐘

工作一：儲存暫停

7. FAQs 常見問題解答

Q1：請問類比輸入通道 (AI) 與輸出通道 (AO) 可設定對應之 scale low 及 scale high 的數值？

A1：類比輸入通道對應 low scale 的最小值為 -19999，-1999.9，-199.99，-19.999，-1.9999，-0.19999，會依所設定的小數點位數而異。

類比輸入通道對應 high scale 的最大值為 45536，4553.6，455.36，45.536，4.5536，0.45536，會依所設定的小數點位數而異。

數學輸入通道對應 low scale 的最小值為 -32768，-3276.8，-327.68，-32.768，-3.2768，-0.32768，會依所設定的小數點位數而異。

數學輸入通道對應 high scale 的最大值為 32767，3276.7，327.67，32.767，3.2767，0.32767，會依所設定的小數點位數而異。

Q2：應用 Ethernet 通訊 (Cat.5 RJ45) 連接電腦與記錄器時，最遠的傳輸距離是多少？

A2：直接連線最遠距離為 100 公尺，若距離超過 100 公尺，可以加上 Hub 或網路橋接器以增強訊號。

Q3：電腦與記錄器透過無線網路 (Ethernet 通訊協定) 直接連線的最遠距離為何？

A3：30 公尺以內。請確認記錄器與電腦之間無障礙物或是高壓纜線，以避免因干擾而導致通訊錯誤，此外在工廠環境中，也可能因設備產生雜訊，並藉著地板傳導而影響無線通訊的正常運作。

Q4：記錄器內有無需要經常更換的電池？

A4：記錄器內安裝一個鋰電池-Toshiba CR2032 3.0V /220mAH 提供 Real time 時間晶片電源，至少可持續使用數年，若電池用完可就近購買、更換。

Q5：記錄器的 Real Time Clock 時間之精度如何？

A5：記錄器的時間晶片每週約延遲幾秒鐘，若需校正時間可利用觀察者二號軟體之即時連線功能，透過乙太網路，執行"同步"將記錄器之時間設定成與連線電腦相同之時間。時間晶片的精度會隨著溫度而有細微的差異：

溫度範圍	延遲時間 (每週)
10~40°C	18 秒
0 或 50°C	52 秒
-10 或 60°C	107 秒

Q6：記錄器可設定密碼嗎？

A6：記錄器提供兩種安全密碼功能，可由使用者選擇

一般密碼功能（標準）：提供一組共用密碼設定。

高階密碼功能（選購）：符合 FDA 21 CFR part 11 之規範（2.2 版後開始提供）。
可提供 30 組（最多）使用者密碼設定，"Adminstrator"層級可以設定 "Supervisor" 與 "Operator" 的授權密碼，Supervisor 可以更改參數、下載或儲存組態及歷史資料。Operator 僅能監看歷史資料、事件資料與狀態。

Q7：什麼是 Boot ROM？與數學功能有關嗎？它可以透 Ethernet 或是 CF 卡升級版本嗎？

A7：Boot ROM 是記錄器內部的啟動式載入器，BootROM BT181 為標準款。BootROM BT182 為選配版，含數學、計次器、累加器與符合 FDA21 CFR part 11 等功能。BootROM 無法透過 Ethernet 或是 CF 卡升級，需升級時必須更換 BootROM 晶片。

Q8：如何更新記錄器韌體與電腦軟體？

A8：若需更新韌體或軟體時，請洽您的供貨商，詢問最新版本軟體的情況。記錄器韌體及 Observer 軟體可以 FTP（檔案傳輸協定）或 Email（Observer 程式安裝檔約 20MB，請確認您所使用的電子郵件信箱可接收如此大容量之檔案），並參考本操作手冊執行更新安裝。

Q9：要更新記錄器韌體時有什麼需要注意的事項？

A9：1、確認韌體版本，若您的記錄器系統韌體為 V1.20 之前的版本，必須分兩階段更新；您必須先更新為 V1.20 版，然後用最新版韌體再執行一次更新，才能更新為最新版的韌體。注意若韌體為 V1.20 版之前的版本，直接更新為最新版的韌體，將造成 DOC 的損壞。

2、確認執行更新的 CF 卡內只有新版系統韌體，不可有其他檔案或資料，否則會造成 DOC 系統混亂。

Q10：電腦軟體觀察者一號及觀察者二號有何差別？

A10：觀察者一號為隨機附贈的免費軟體，可用來設定記錄器參數或是讀取歷史資料；觀察者二號為選購軟體，多了即時連線監看的功能。

Q11：一台記錄器最多可使用多少 AI、AO、DI、DO、以及 24V DC 輔助電源卡？

A11：最多可用 6 張卡，IO 卡的類型可視使用需要彈性組合。

Q12：記錄器可以支援更大容量的 CF 卡嗎？推薦的廠牌為何？

A12：本公司另提供 256MB 及 1GB 容量之 CF 卡可供選購，相容性上我們建議以“SanDisk”為佳。

Q13：記錄器的保固期多長？使用者的記錄器有問題時該怎麼辦？

A13：記錄器的保固期為 18 個月（自出廠日起算），若記錄器有任何問題時，請聯絡您的供應商。

Q14：如過記錄器的內部記憶體滿了之後資料會依什麼程序下載到 CF 卡？

A14：當 8MB 的內部記憶體滿了之後，記憶體內最早的事件與良策資料會一批批自動儲存到 CF 卡，詳情參考 3.11 小圖示。

Q15：記錄器的警報標題可以顯示特別設定的訊息嗎？

A15：警報的標題是內建幾種固定文字格式，無法另行設定所需顯示的文字訊息警報的標題會隨著警報、事件、的發生，或是 CF 卡、內部記憶體執行下載而出現。您也可以設定警報或事件發生時觸發蜂鳴器。

Q16：類比與數學通道的訊號可以再傳送出來嗎？

A16：類比輸入通道以及數學（選配）通道的訊號可以用“AO-類比輸出卡”再傳送，記錄器共有六個插槽（最多可插 6 張 AI/AO/DI/DO 等），類比輸出卡有兩種型式，即 3 通道電流輸出之 AO183I(4~20mA)與 3 通道電壓輸出之 AO183V(0~10V)。

Q17：記錄器可以支援 OPC server 嗎？

A17：目前的 VR18 記錄器不支援 OPC server，但是觀察者二號提供了 DDE 解決方案，以交換其他如 PLC、SCADA 等裝置之數據。請參考章節 5.5 DDE 動態資料交換。

Q18：記錄器支援那些通訊協定以及硬體介面？

A18：記錄器可支援乙太網路 TCP/IP 通訊協定以及 RS232/422/485 Modbus RTU 通訊（選配）協定。

Q19：網路內最多可連幾台記錄器？

A19：可連接的記錄器台數是通訊介面而有不同：

- 1、Ethernet—最多可連接 255 台（每台設定特定的 IP 位址）。
- 2、RS485—247 台。

Q20：電腦“觀察者二號”即時連線軟體最多可連接幾台記錄器？

A20：觀察者二號同一即時連線專案內至多可納入 1024 筆通道。這裡的通道泛指記錄器 I/O 輸出及輸入的通道，包括 AI、數學、DI、DO、計數器、累加器與 AO。以一台標準規格 6 通道的記錄器為例，最多可連接 170 台。

Q21：若是忘記記錄器上已設定的密碼時，有其他通用密碼可以進入嗎？沒有的話有其他方式可以回復未設密碼前的廠設值嗎？

A21：記錄器內沒有通用密碼的設定，但可以回復到未設密碼前的廠設值。

RESET 程序如下：

關閉電源並按住（一直按著）左排最上方之按鍵-打開電源（此時仍繼續按著按鍵）-出現兩聲‘嗶’後才放開按鍵然後再關機重開。記錄器便回復到廠設值，一旦完成 RESET 程序後，先前所設定的所有組態都會消失，您必須重新設定你所需的組態。

Q22：若要改變類比輸入的訊號設定，除了關閉電源取出 AI 卡調整 JUMP 跟 DIP Switches 之外還要完成其他動作嗎？

A22：在設定 Jump 與 DIP Switches 後，您需要在 Observer 執行“接收組態”的動作，以同步修改電腦上的記錄器組態，這樣才不會影響連線功能。

Q23：與記錄器 Ethernet 連線時要用何種網路線？

A23：透過 HUB-使用標準 Cat.5 RJ45 接頭之線材。

直接連接電腦與記錄器-Cat.5 RJ45 接頭的網路跳線。

Q24：CF 卡的容量與可儲存的天數？

A24：可儲存的天數會因 CF 卡容量、使用的通道數與取值記錄的速度而有不同，以 6 通道輸入為例，CF 卡容量與可儲存天數如下表所列：

	CF 卡容量	32MB	256MB	1GB
取值速度				
1 秒		30 天	240 天	960 天
10 秒		300 天	2400 天	9600 天
120 秒		3600 天	28800 天	115200 天

Q25：記錄器可以再同一個畫面同時顯示所有通道嗎？

A25：可以。按左排 **頁面** 鍵，選擇全部，一個畫面最多可同時顯示 36 個通道數值（數字型），當通道數超過 36 筆時，可運用畫面中的方向鍵移動所須顯示的通道。

Q26：可以從記錄器列印出所選擇時間範圍內的資料嗎？

A26：請注意！記錄器無法直接連接印表機，來列印資料。若需列印資料時您可參考下

列方法：

- I) 進入電腦軟體的 Historical 畫面，選取所需列印的時間範圍與通道，執行列印
電腦螢幕上方有列印功能的小圖示)
- II) 在 Historical 將欲選擇的時間範圍內之資料轉換成 Excel 檔，在進入 Excel 列
印出來。

Q27：記錄器可提供幾組計時器、計數器與累加器？

A27：6 組計時器(標準配備)、6 組計數器(選配)、18 組累加器(選配)。

Q28：DI 輸入可以應用於計算嗎？

A28：記錄器可以偵測的最大頻率為 30 pulses/每分鐘(0.5Hz)。或者您可以在市
面上買到 Pulse 轉 4~20mA 訊號的轉換器(接入 AI)。

Q29：當使用者開始使用觀察者軟體時，電腦上若出現下頁訊息方塊時，該怎麼
處理？



A29：此訊息代表觀察者的軟體檔案發生錯誤，有可能是電腦感染病毒造成或是
某些安裝的新軟體與作業系統不相容。建議您參照"Real time viewer"
或"Histroical viewer"的說明--"observerI & observer II PC software manual"
章節 1.1.4 移除舊的 observer 軟體，然後置入新版觀察者軟體光碟，執行
安裝。若還是無法解決，請先移除已安裝之觀察者軟體，然後新增"historical"
跟"real-time"備份檔案夾在 C:/Observer，然後移除 C 槽下的 Observer 檔案
夾。再執行一次安裝。

Q30：如何備份觀察者資料及組態資料？

A30：觀察者的資料是以副檔名".dat"、".idx"以及".lst"等檔案儲存於 C : Observer
路徑下的"histroical"與"realtime"檔案夾內。組態資料檔名為"Recorder.cfg"。
有需要備份時，您只需新建立新的資料夾，再將"histroical"與"realtime"檔案
夾全部複製至此資料夾內即可，然後便可轉存

Q31：如果在組態設定上有問題時，我應該提供哪些檔案給供應商來分析？

A31：若是組態的設定問題，您應該將"recorder.cfg"與"IO.dat"兩個檔案 Email 給供應商分析(儲存位置在 C：Observer/historical 的檔案夾內)

Q32：VR18 記錄器可以提供輔助電源給傳送器使用嗎？

A32：記錄器可以選配 AP181 輔助電源卡，一張輔助電源卡可提供 6 組 24VDC 的輔助電源。

Q33：我想用 RS232/RS422/RS485/Ethernet 來連接記錄器，但不知道該怎麼設定相關的通訊組態？

A33：關於通訊連線設定，您可以參考操作手冊之 5.1 觀察者一號與觀察者二號電腦軟體說明、5.2 Ethernet 組態設定、5.3 RS232，RS422，RS485 組態設定。

Q34：當將資料轉換成 Excel CSV 檔案格式後，在 Excel 的工作表欄位上內找不到歷史資料？

A34：請確認您有確實將需要轉換的通道資料選入"目標列"內。若是需轉檔的通道還在"來源列"內，請先移到目標列，再輸出成 Excel 檔格式。另外，確認所選取的時間區間內確實有通道的歷史記錄，否則在 Excel 檔案內將看不到資料數值。

Q35：數學應用可以用 pulses 訊號來計算每小時耗電瓦數嗎？

A35：可以，首先您需要選配數學運算功能，並選購 DI(數位輸入卡)來接收 pulses 訊號，並依下列方式設定：

I 進入 DI 通道設定

II 事件型式：High 工作 1：計數器累加 目標：計數器 1

III 注意：記錄器最大值為 65535

DI 卡有效 pulses 訊號頻率為每分鐘 30 pulses(0.5 Hz)，最好的方式是加一個 Pulse 轉 4~20mA 訊號的轉換器。